


MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 13:56:40
Durée: 5mn 16s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SAMOURA ALHASSANE	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	BCEIP
ID	24032813474609796

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

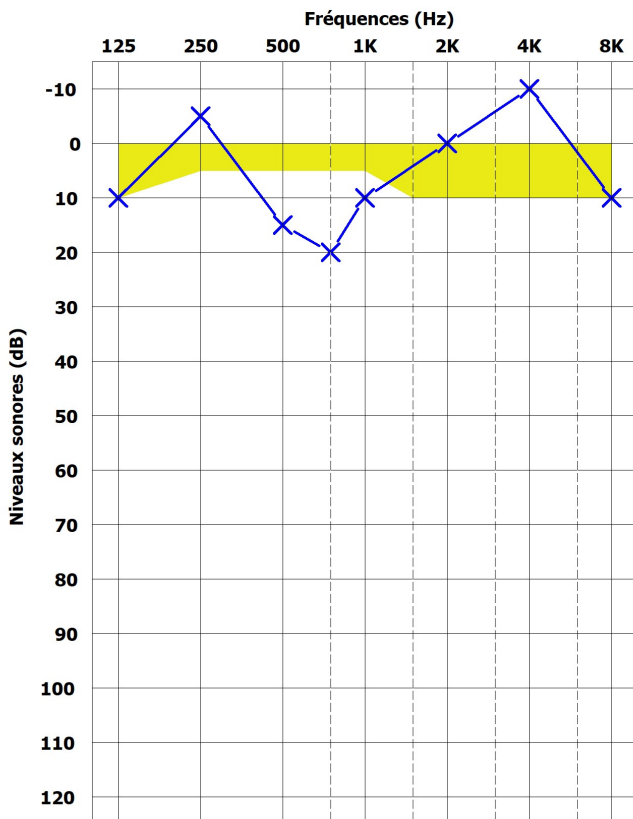

Oreille Gauche

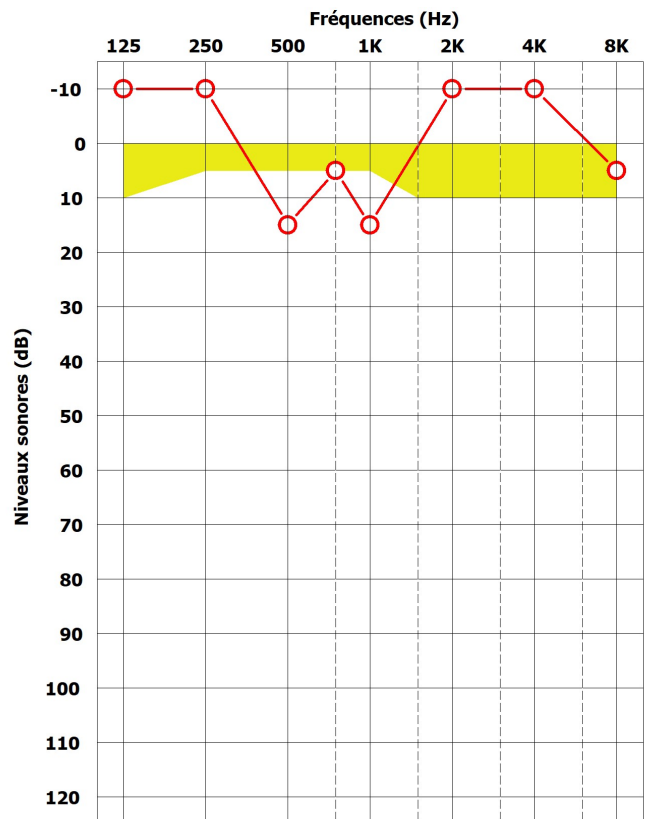

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	-5	15	20	10		0		-10		10
CA Droit	-10	-10	15	5	15		-10		-10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes