

MEDVIE


Date du test: 16/09/2024 12:12:05

Durée: 5mn 32s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MARA MOHAMED	
Date de naissance	23/06/1990
Age	34
Société	BCEIP
ID	24091612100039284

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

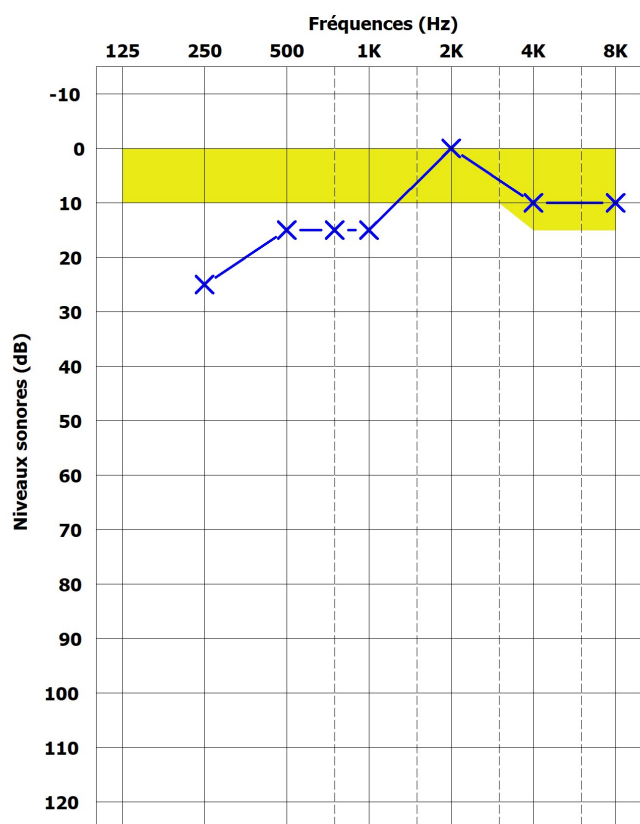

Oreille Gauche

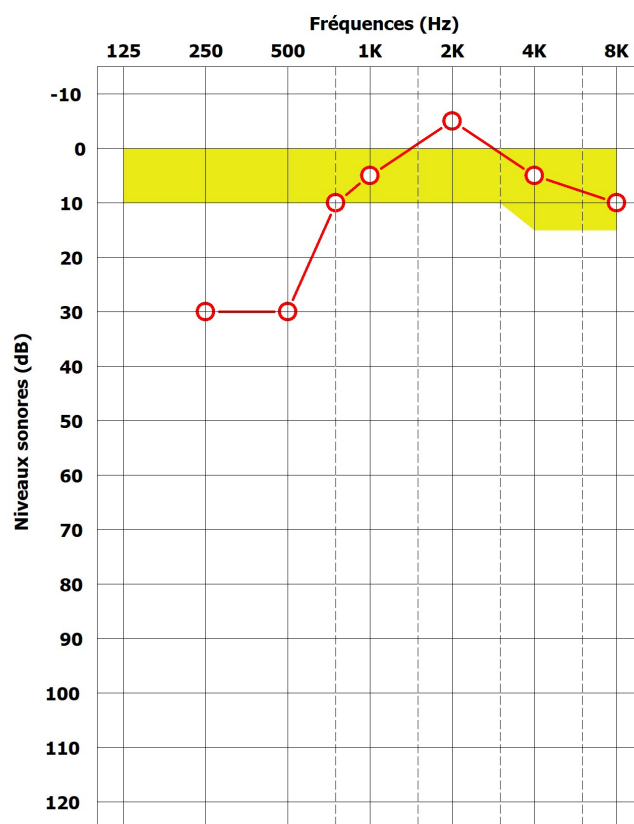

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	15	15		0		10		10
CA Droit		30	30	10	5		-5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes