



Données Patient		FOFANA N'GAFING
Date de naissance	01/01/1975	
Age	49	
Société	BCEIP	
ID	24081910053894277	

Date du test: 04/11/2024 13:42:27
 Durée: 4mn 59s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

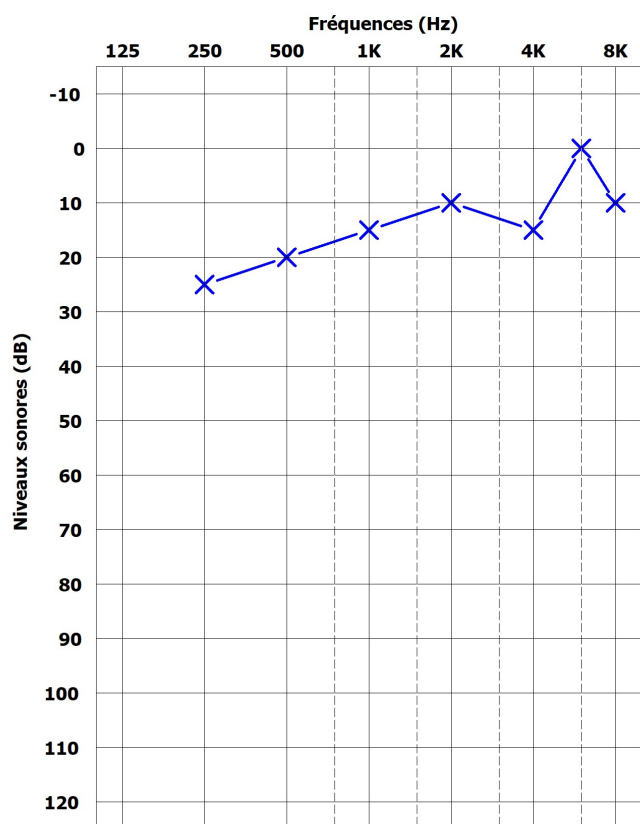

Oreille Gauche

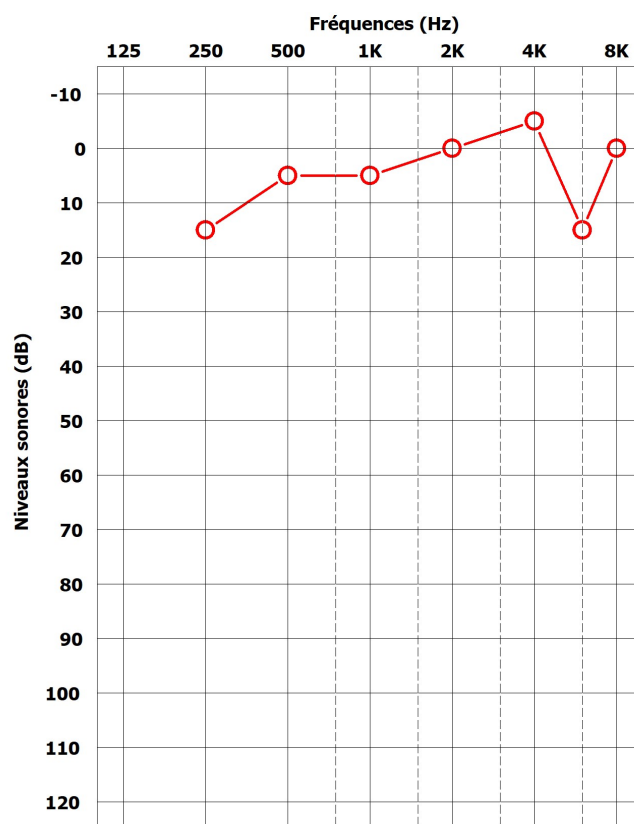

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20		15		10		15	0	10
CA Droit		15	5		5		0		-5	15	0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes