

MEDVIE


Date du test: 04/06/2024 12:21:19

Durée: 4mn 40s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KABA BOUNAF
Date de naissance	20/06/1987	
Age	36	
Société	MV/BCEIP	
ID	24060412181353229	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

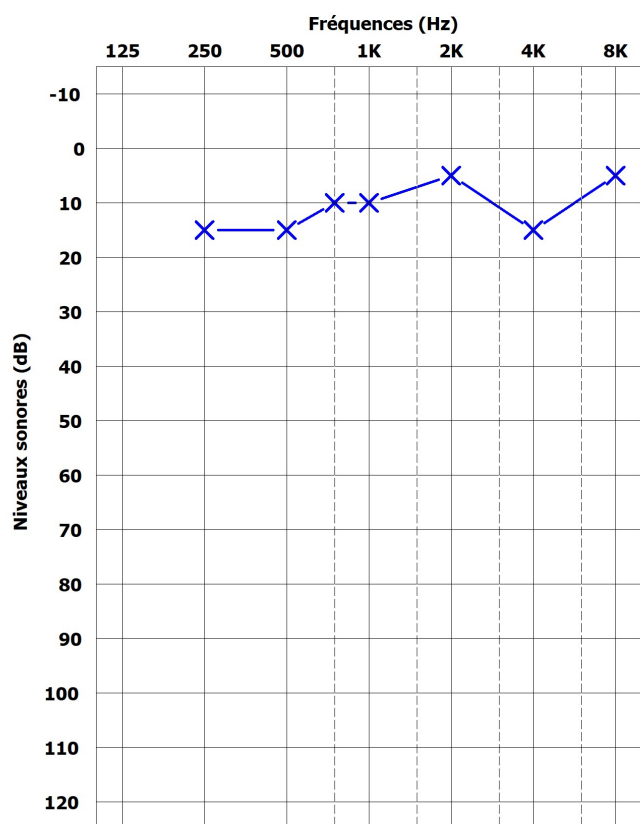

Oreille Gauche

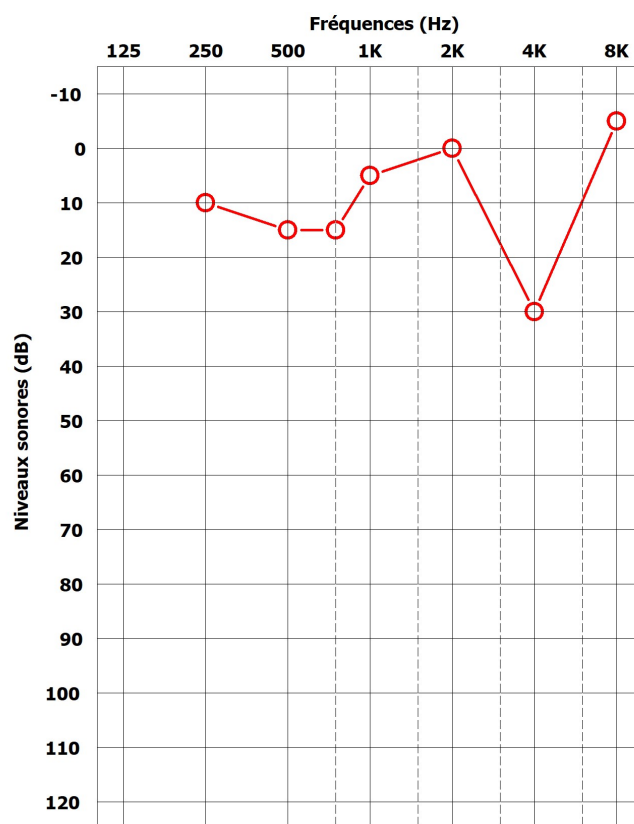

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	10		5		15		5
CA Droit		10	15	15	5		0		30		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes