


MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 12:40:26
Durée: 3mn 46s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAYO Ousmane	
Date de naissance	15/07/1991
Age	32
Société	bceip
ID	24070512313538113

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

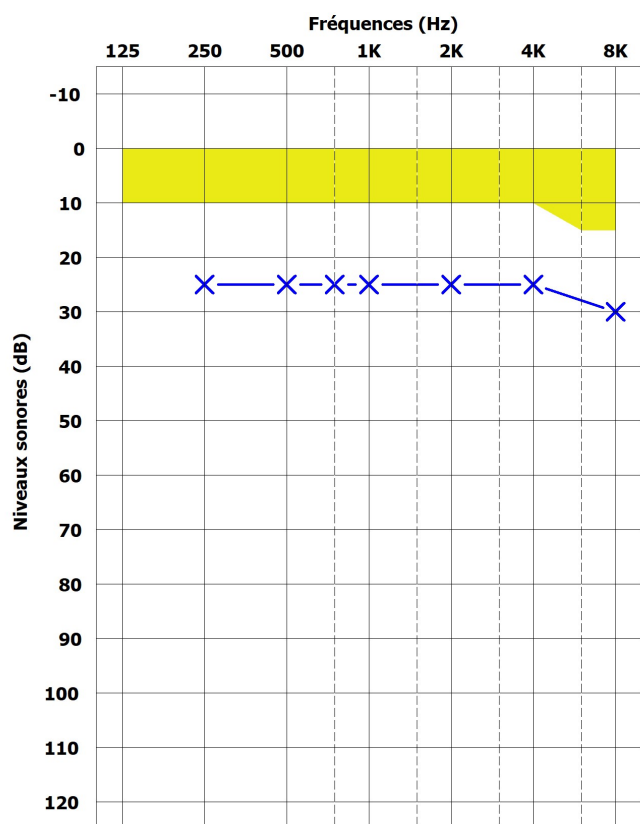

Oreille Gauche

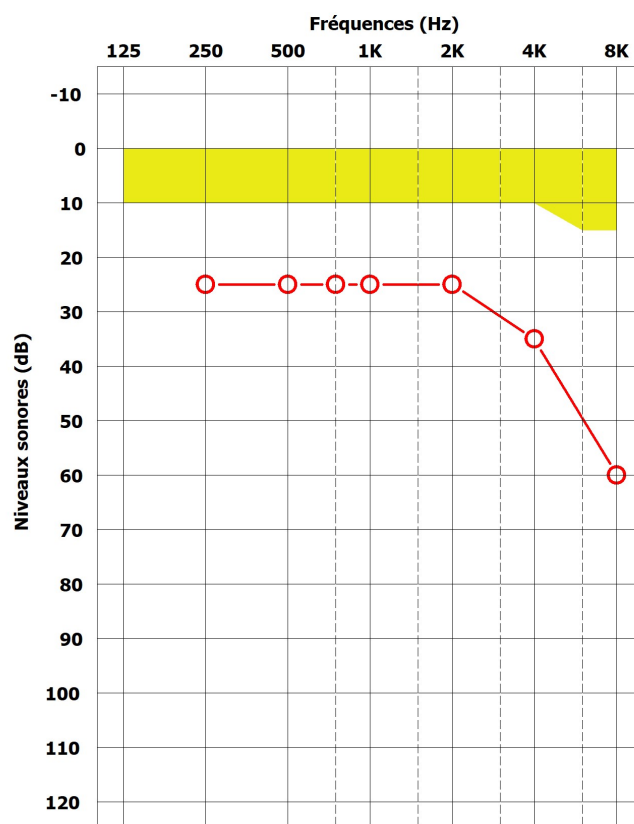

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	25		25		25		30
CA Droit		25	25	25	25		25		35		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes