


MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 15:08:43
Durée: 3mn 18s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE SAYON
Date de naissance	05/07/1990	
Age	33	
Société	BCEIP/277	
ID	24050615062930331	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

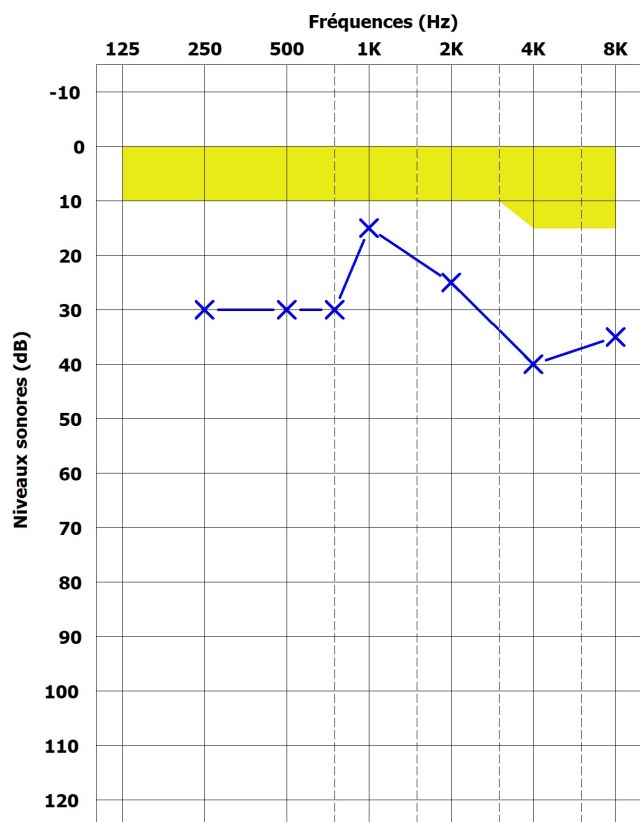

Oreille Gauche

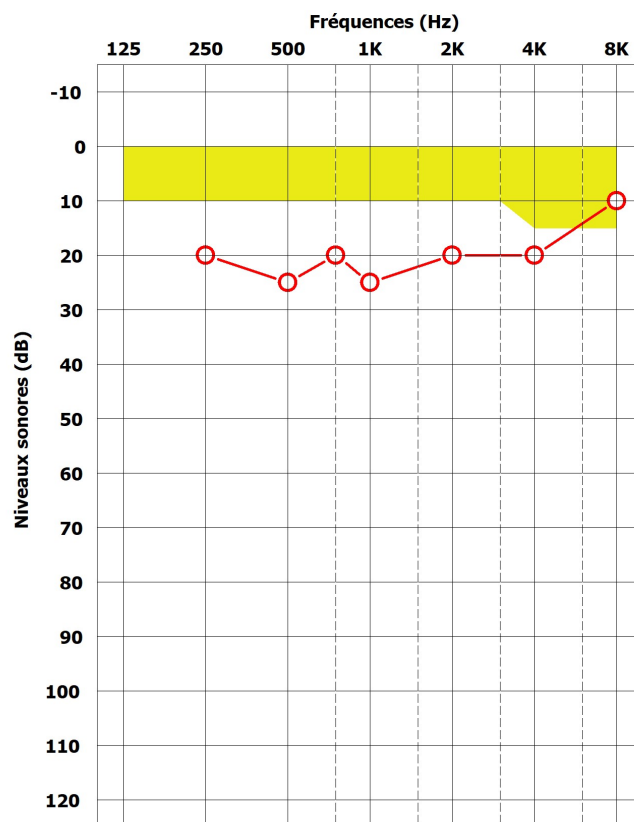

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	30	15		25		40		35
CA Droit		20	25	20	25		20		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes