

MEDVIE


Date du test: 08/07/2024 13:45:17

Durée: 4mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA SEYDOU	
Date de naissance	01/01/1972
Age	52
Société	BCEIP
ID	24070813431570289

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

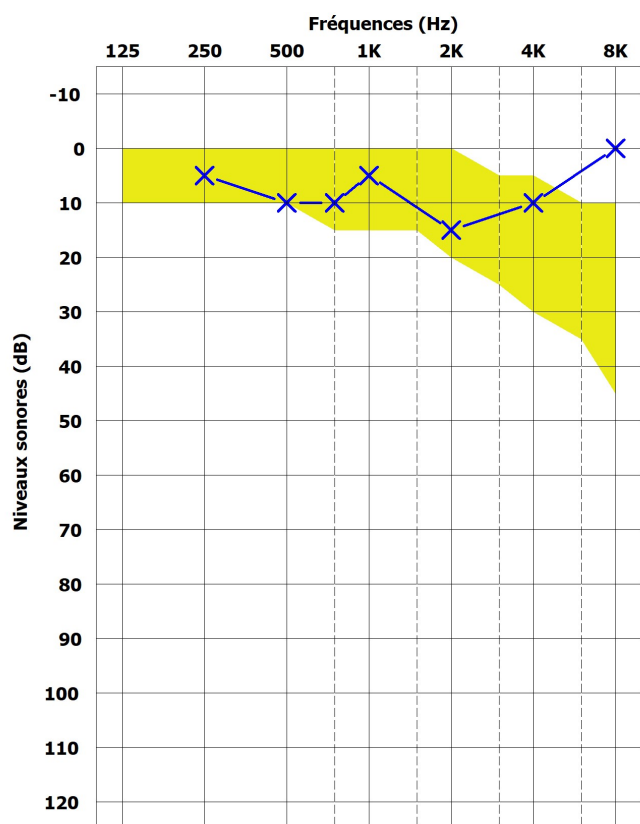

Oreille Gauche

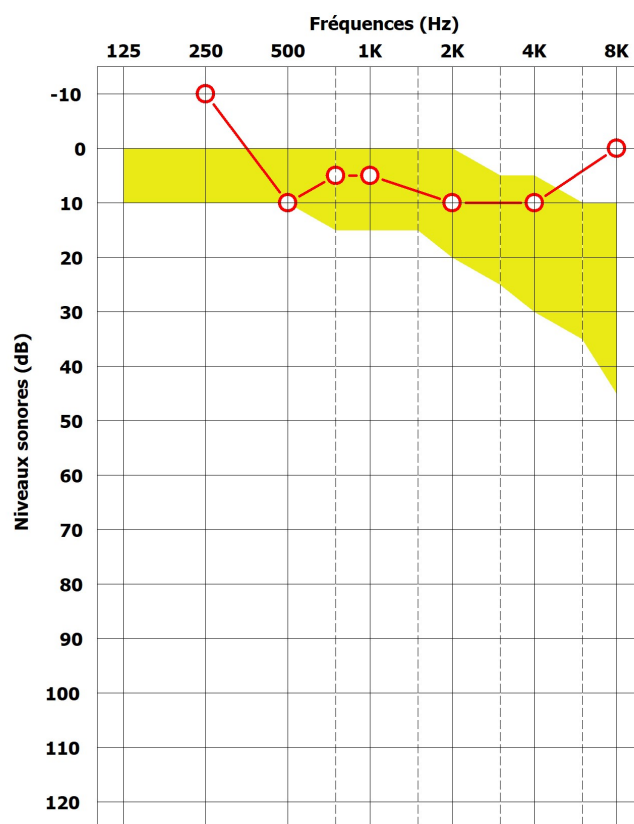

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		15		10		0
CA Droit		-10	10	5	5		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes