


Données Patient		DOUMBOUYA SORY
Date de naissance	06/05/1995	
Age	29	
Société	BECEIP	
ID	24110411385877250	


MEDVIE

Date du test: 04/11/2024 11:41:04
 Durée: 5mn 03s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

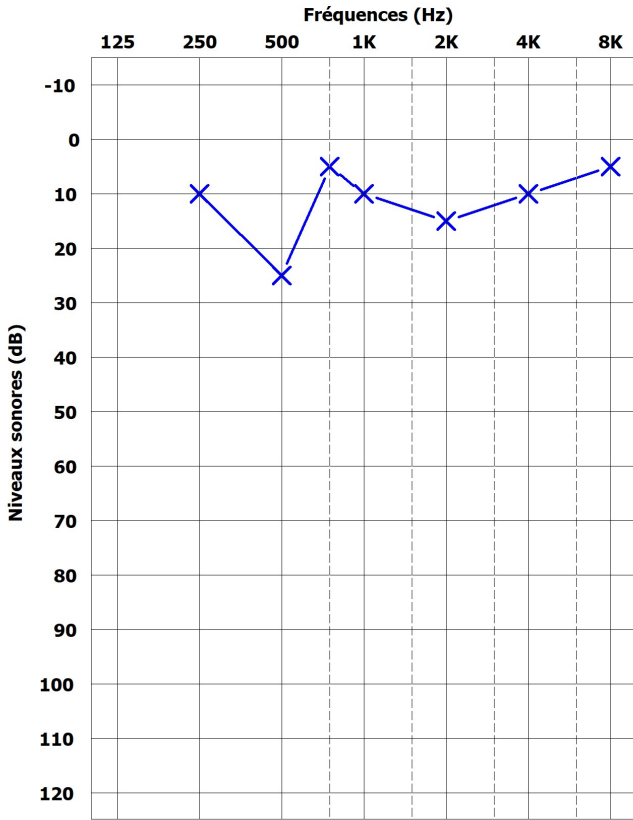

Oreille Gauche

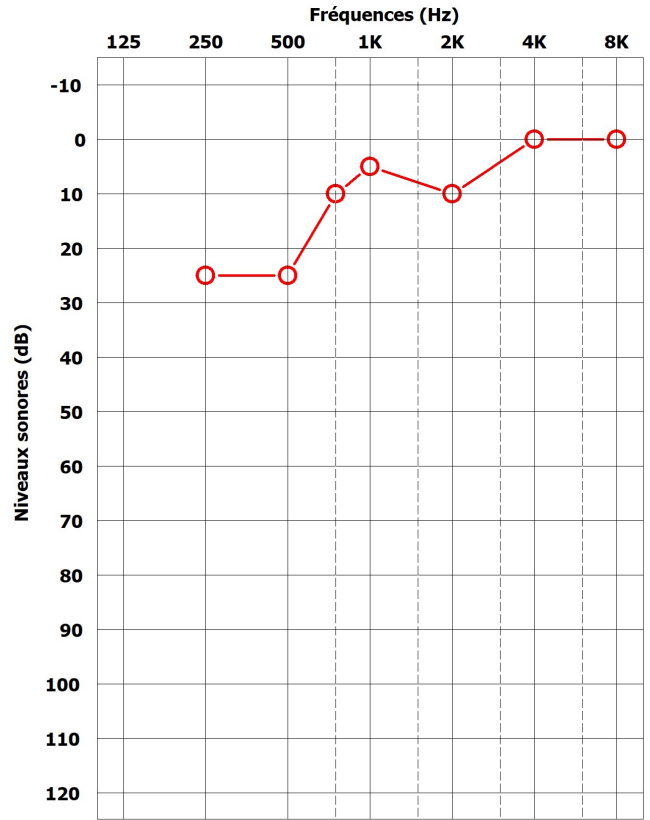

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	5	10		15		10		5
CA Droit		25	25	10	5		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	15,0 dB
CA Droit	10,0 dB	---

Notes