



| Données Patient   |                   | BERETE N'VAMBA |
|-------------------|-------------------|----------------|
| Date de naissance | 01/01/1997        |                |
| Age               | 27                |                |
| Société           | MV/BCEIP/151      |                |
| ID                | 24032811251986732 |                |

Date du test: 28/03/2024 11:28:48  
Durée: 5mn 02s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

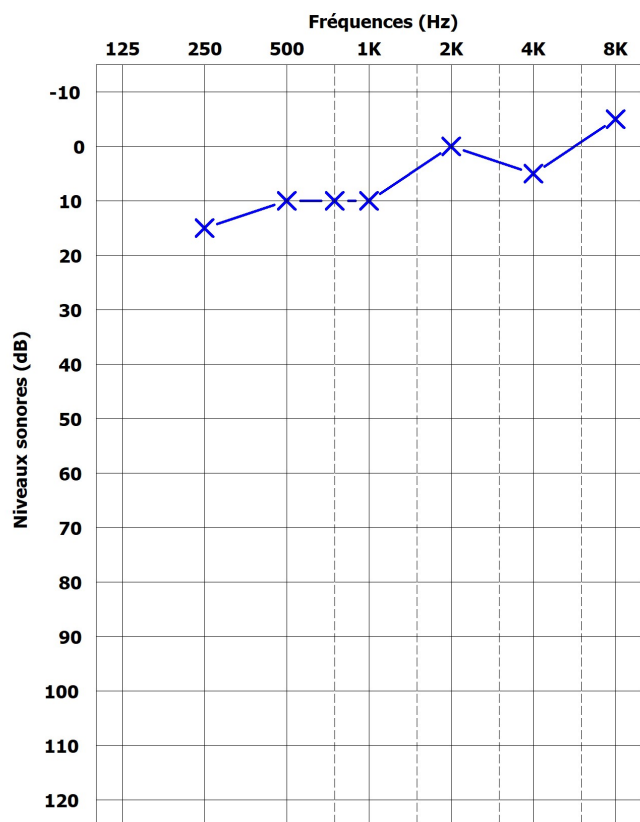

Oreille Gauche

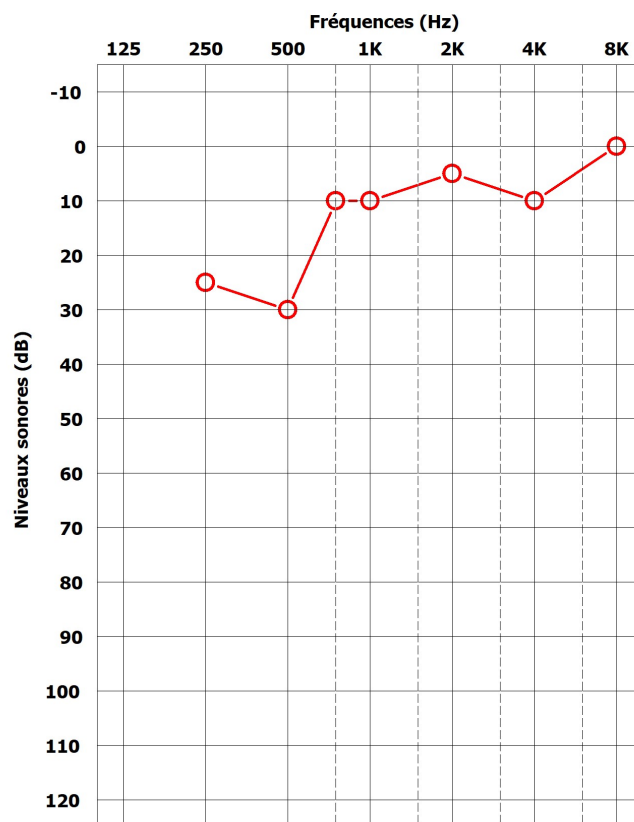

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 10  | 10  | 10 |     | 0  |    | 5  |    | -5 |
| CA Droit  |     | 25  | 30  | 10  | 10 |     | 5  |    | 10 |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 6,3 dB  | --- |
| CA Droit        | 13,8 dB | --- |

Notes