

MEDVIE


Date du test: 13/09/2024 14:15:06

Durée: 6mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE OUMAR KOLY	
Date de naissance	30/06/1971
Age	53
Société	BCEIP
ID	24091314130833000

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

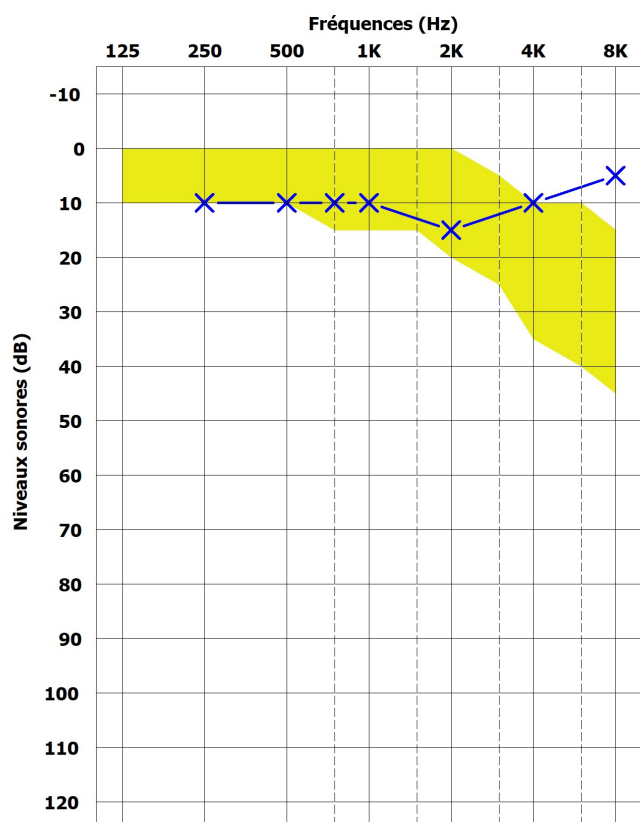

Oreille Gauche

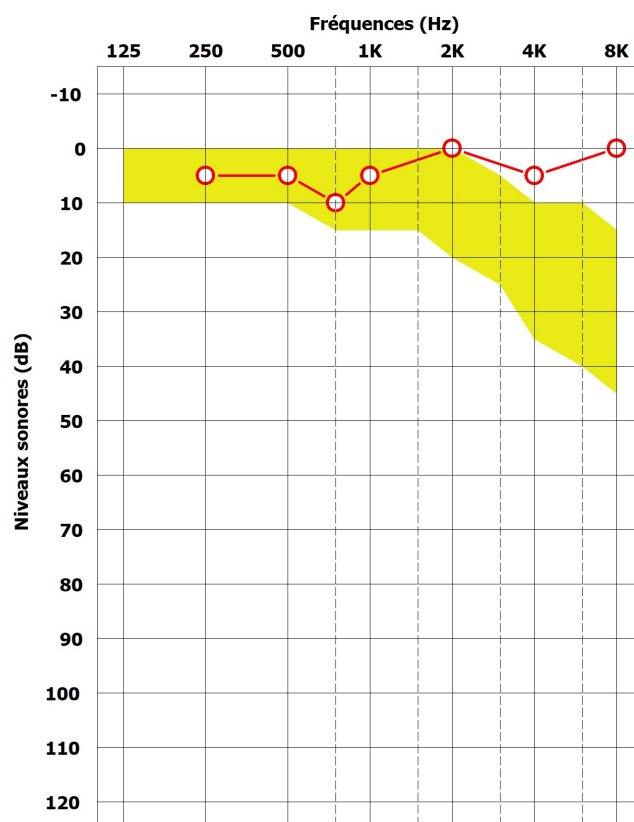

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	10		15		10		5
CA Droit		5	5	10	5		0		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes