


MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 17:08:30
Durée: 5mn 29s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIALLO ALIMOU
Date de naissance	01/01/1985	
Age	39	
Société	BCEIP/291	
ID	24050616432994593	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

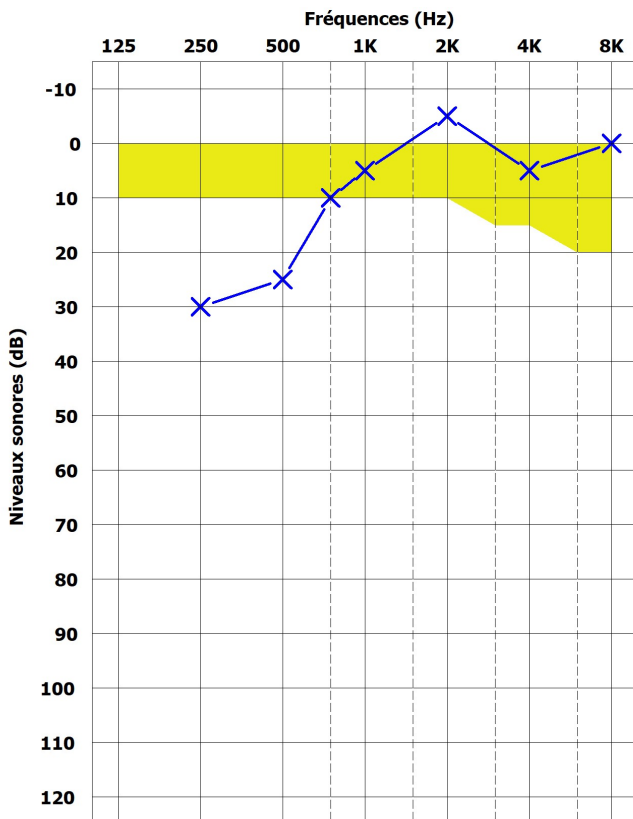

Oreille Gauche

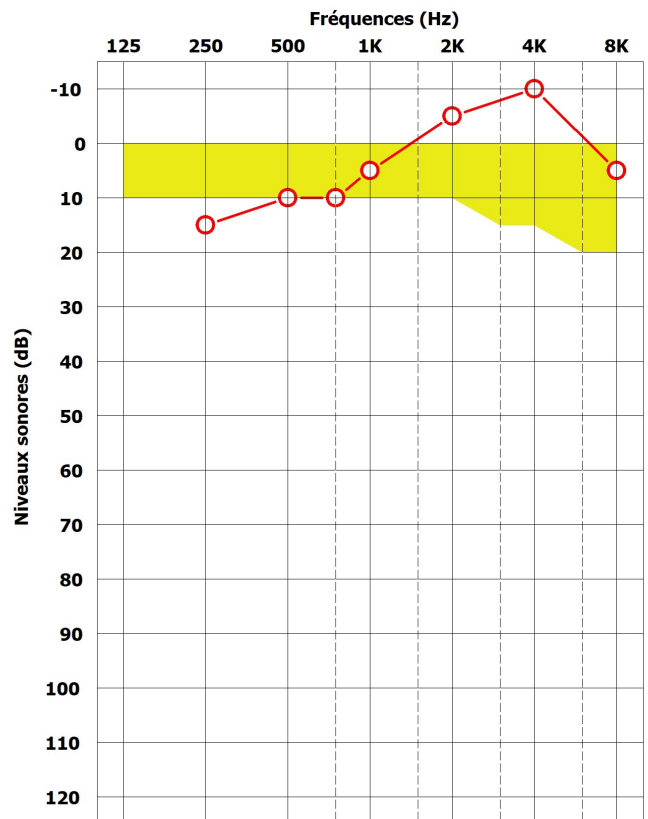

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	10	5		-5		5		0
CA Droit		15	10	10	5		-5		-10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes