

MEDVIE

Date du test: 05/07/2024 14:35:57

Durée: 3mn 29s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

TRAORE MAMADY

Date de naissance

01/01/1993

Age

31

Société

BCEIP

ID

24070514332270704

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

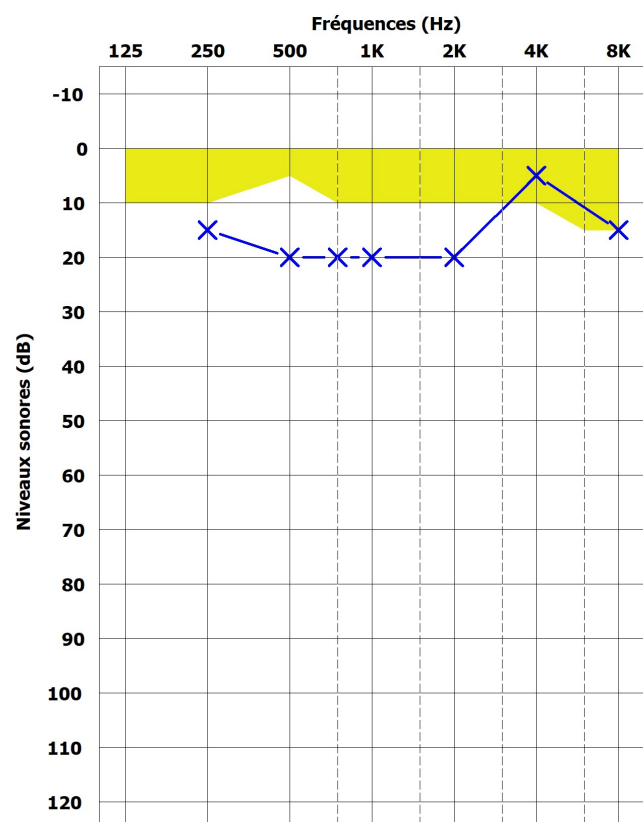

Oreille Gauche

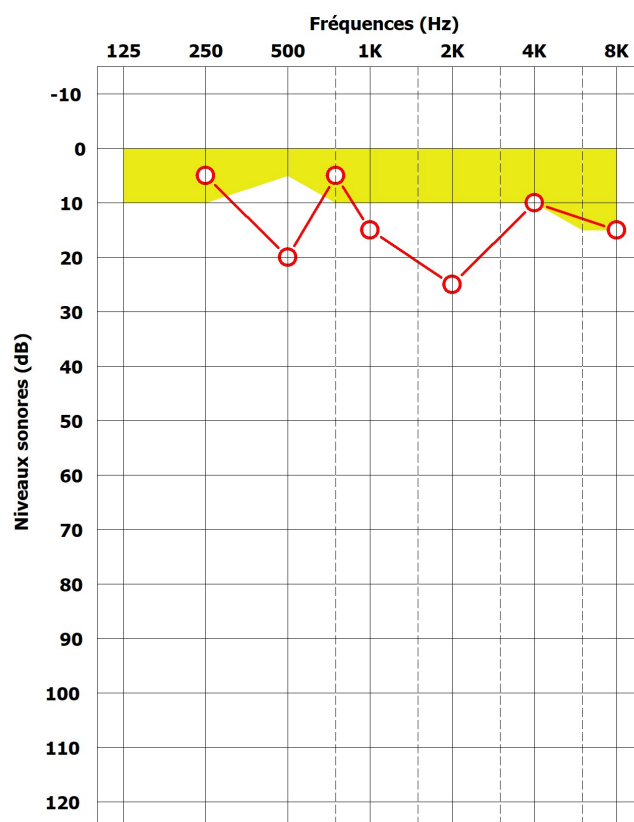

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	20	20		20		5		15
CA Droit		5	20	5	15		25		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes