


MEDVIE

Date du test: 15/04/2024 09:07:02

Durée: 7mn 48s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

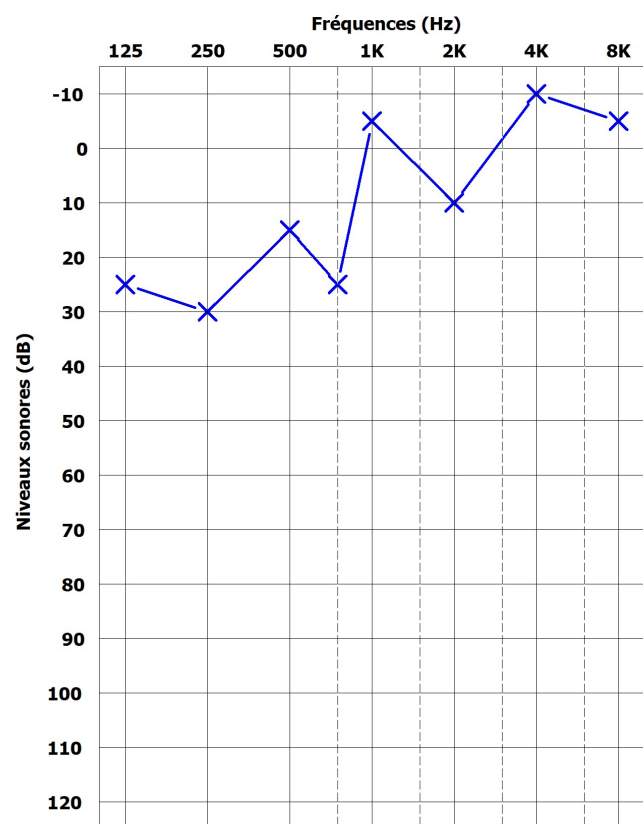

Oreille Gauche

Données Patient	
	DOUMBOUYA SOUFI EYMANE
Date de naissance	19/05/1985
Age	38
Société	BCEIP
ID	24041509025667030

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

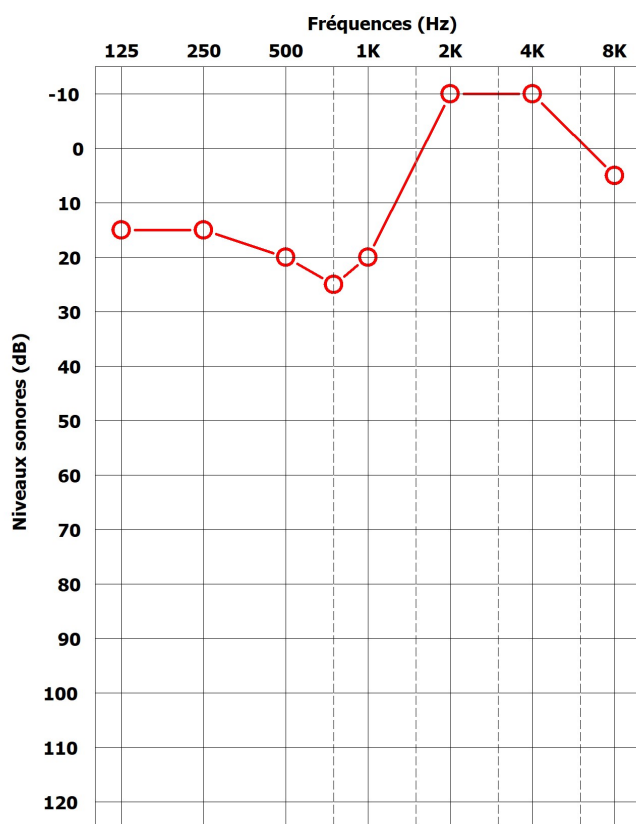

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	30	15	25	-5		10		-10		-5
CA Droit	15	15	20	25	20		-10		-10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes