


MEDVIE

Date du test: 29/03/2024 14:24:31

Durée: 9mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

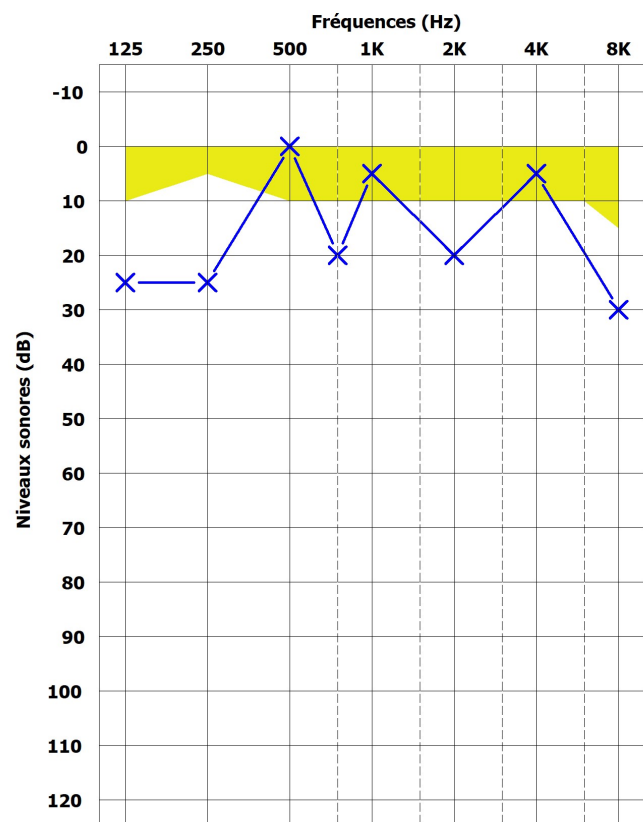

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA SENY	
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	BCEIP
ID	24032914212638113

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

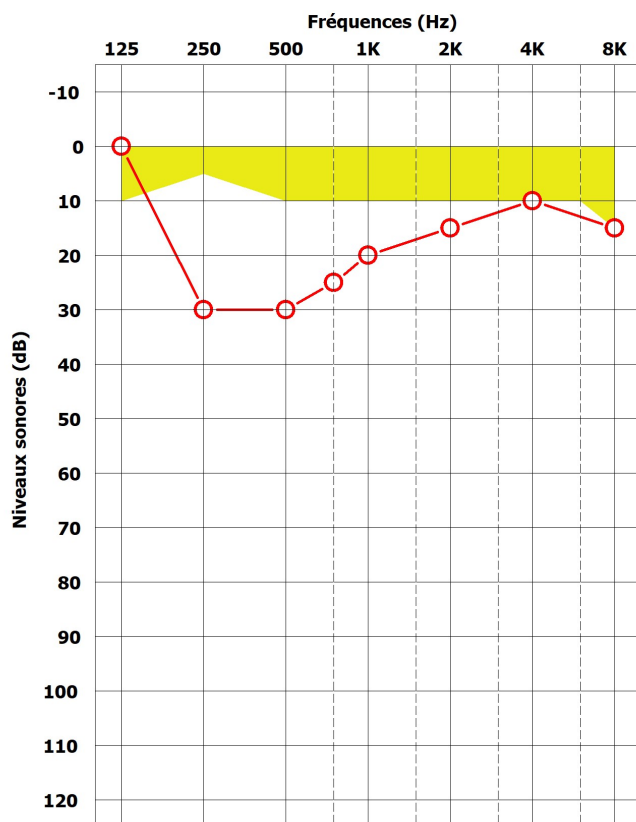

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	0	20	5		20		5		30
CA Droit	0	30	30	25	20		15		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes