

MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 11:28:34

Durée: 9mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUUROUMA BANGALY	
Date de naissance	01/01/1972
Age	52
Société	BCEIP
ID	24032911185755760

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

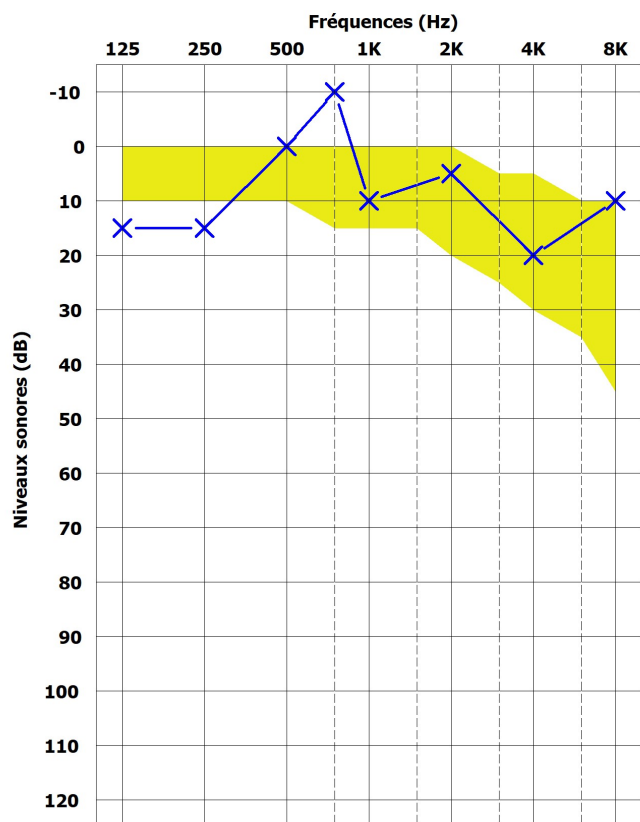

Oreille Gauche

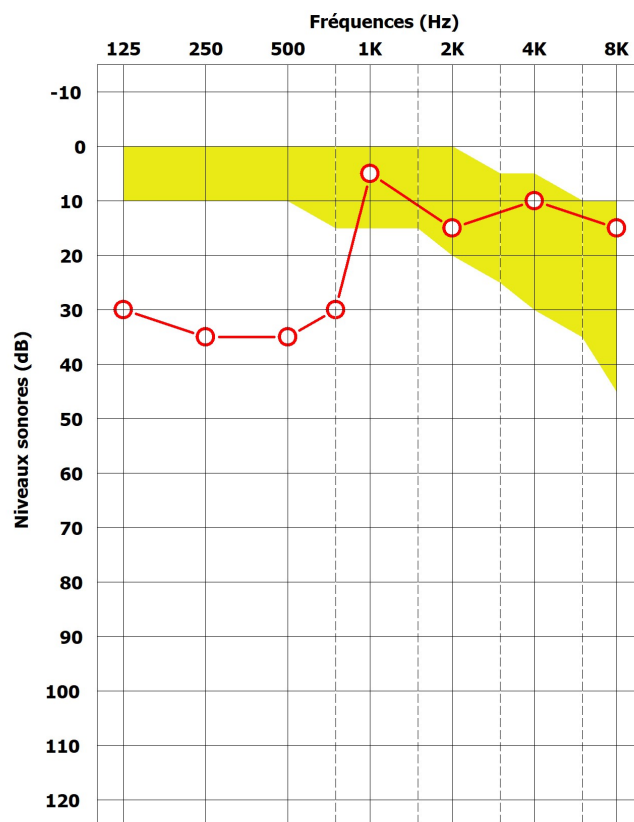

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	0	-10	10		5		20		10
CA Droit	30	35	35	30	5		15		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes