

MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 13:30:31

Durée: 4mn 34s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA FATOUMATA	
Date de naissance	12/12/2000
Age	23
Société	BCEIP
ID	24070513185447545

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

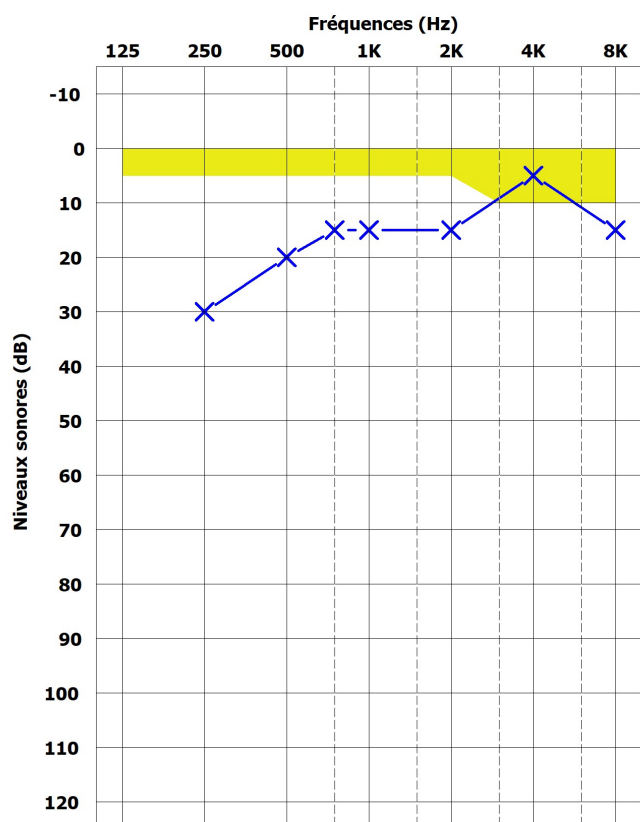

Oreille Gauche

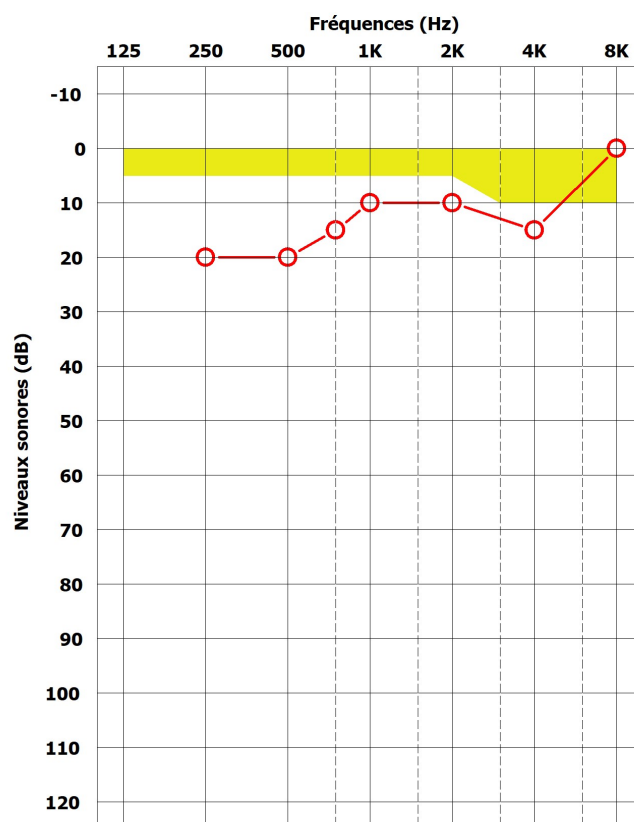

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	15	15		15		5		15
CA Droit		20	20	15	10		10		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes