

MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 16:30:50

Durée: 5mn 03s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SAGNO ALAIN
Date de naissance	04/02/1994	
Age	30	
Société	BCEIP	
ID	24070516290550414	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

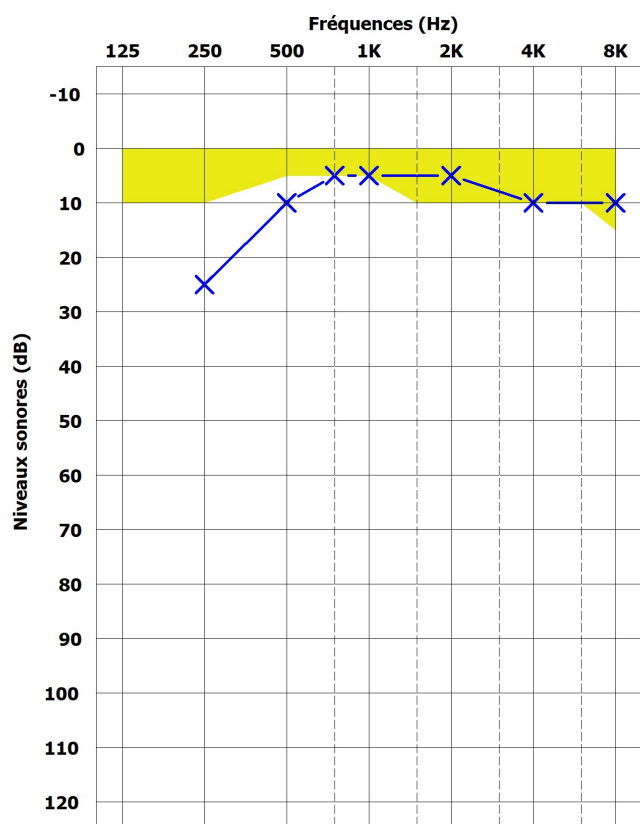

Oreille Gauche

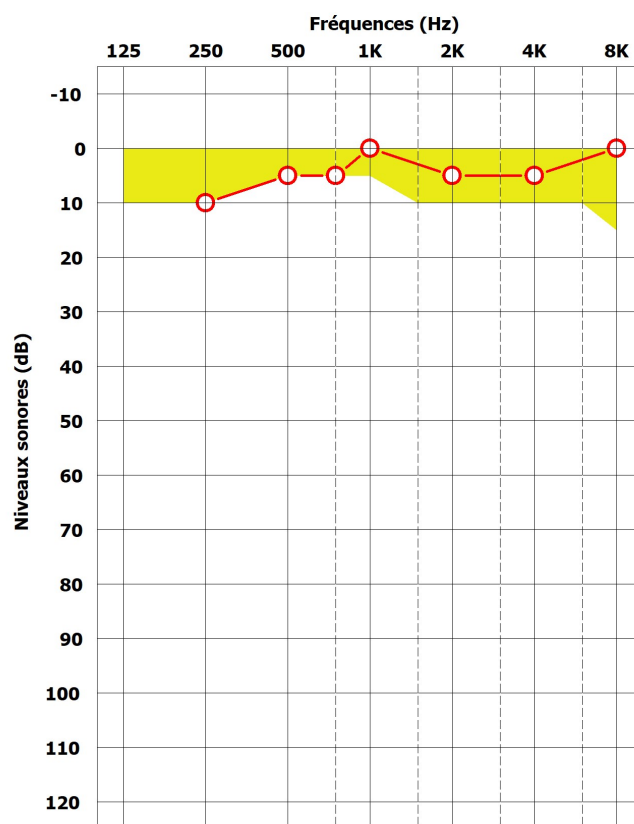

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	5	5		5		10		10
CA Droit		10	5	5	0		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes