


MEDVIE

Date du test: 04/06/2024 12:09:55

Durée: 5mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

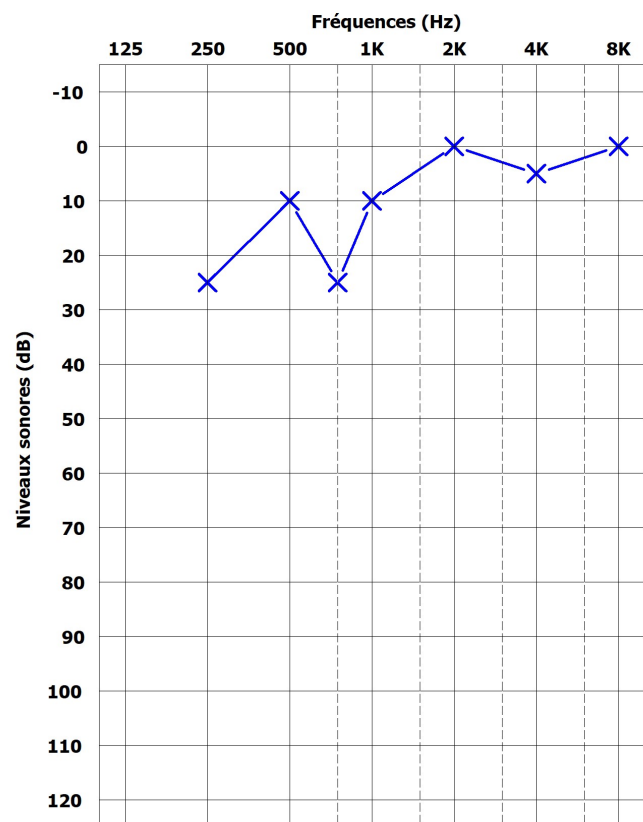

Oreille Gauche

Données Patient	
TRAORE ROGER MANIMOU	
Date de naissance	01/07/1988
Age	35
Société	BCEIP
ID	24060412052825078

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

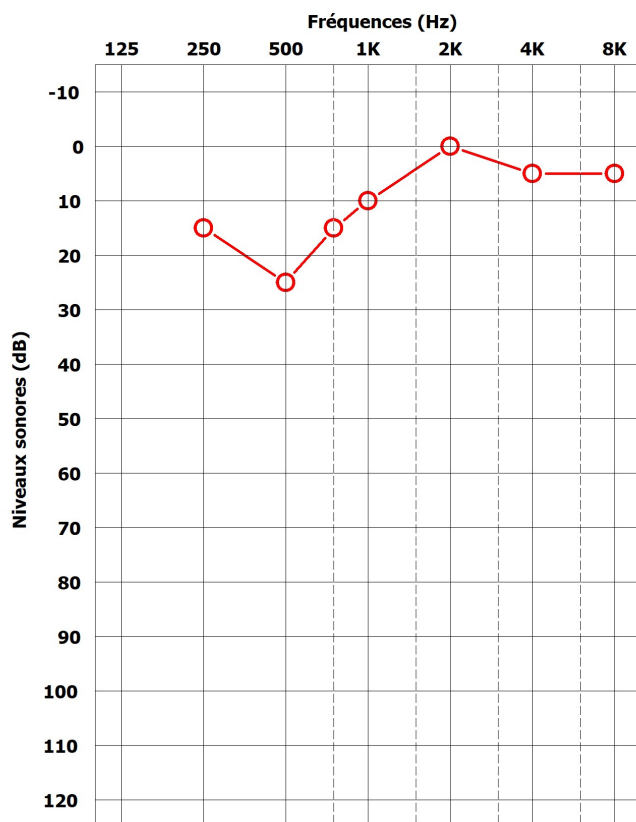

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	25	10		0		5		0
CA Droit		15	25	15	10		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes