

MEDVIE

Date du test: 07/05/2024 14:30:48

Durée: 5mn 17s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **BANGOURA ABOUBACAR**

Date de naissance 01/01/1988

Age 36

Société BCEIP


ID 24050714282647205

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

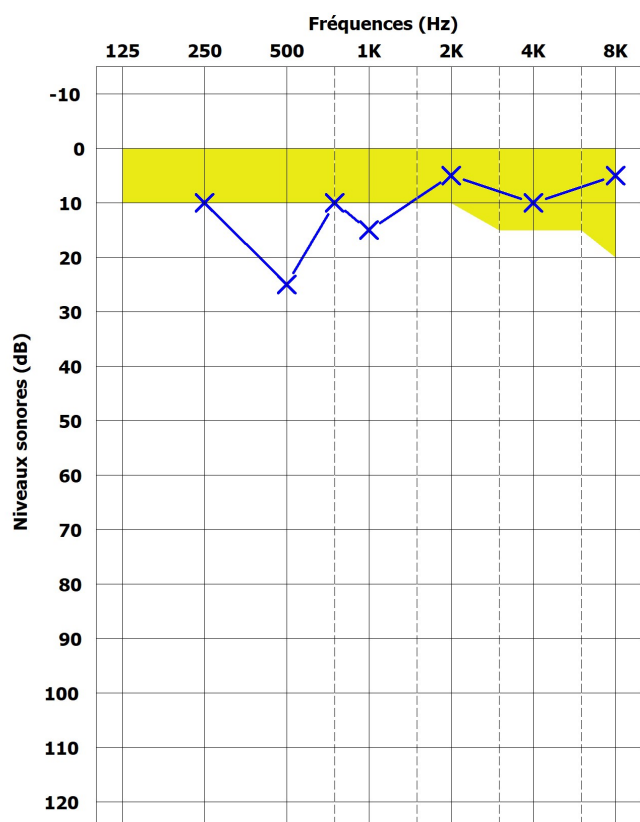

Oreille Gauche

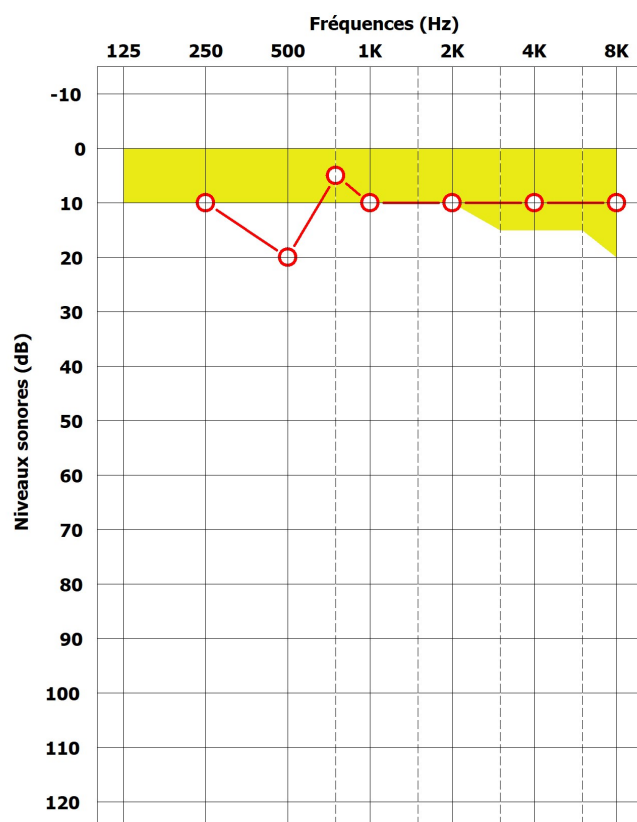

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	10	15		5		10		5
CA Droit		10	20	5	10		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes