


MEDVIE


Date du test: 07/05/2024 15:31:41  
Durée: 5mn 18s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | SOUARE SEKOU |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Date de naissance | 01/10/1990        |              |
| Age               | 33                |              |
| Société           | BCEIP             |              |
| ID                | 24050715294251963 |              |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

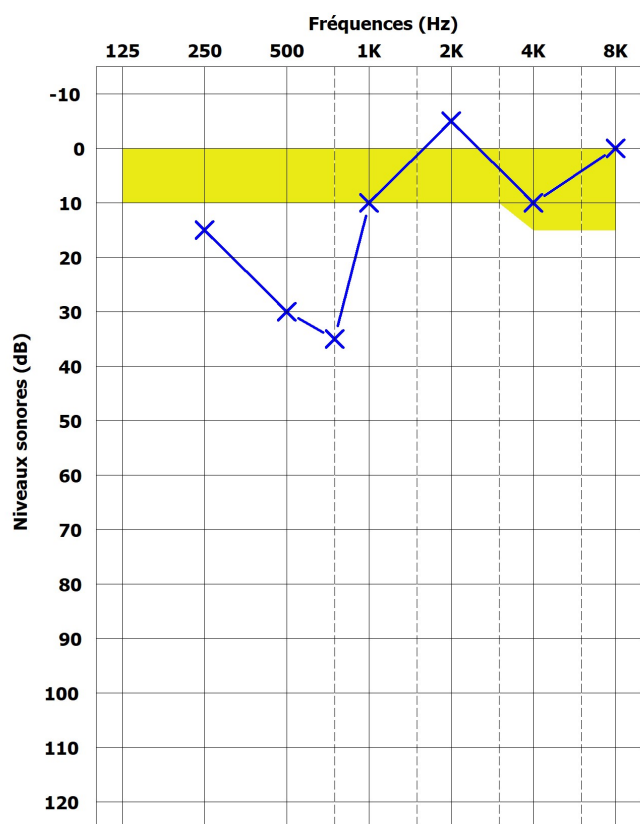

Oreille Gauche

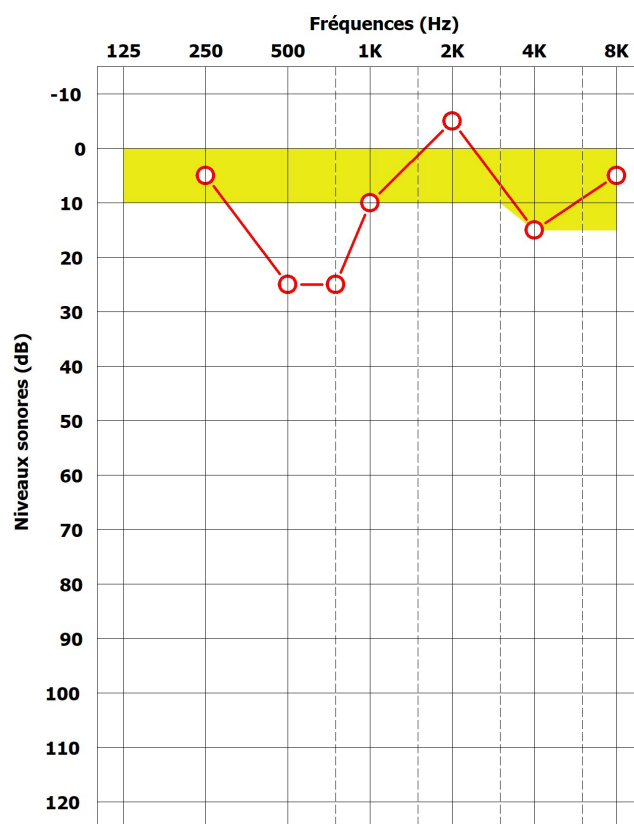

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 30  | 35  | 10 |     | -5 |    | 10 |    | 0  |
| CA Droit  |     | 5   | 25  | 25  | 10 |     | -5 |    | 15 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 11,3 dB | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes