

Données Patient

CAMARA MANDJAN

Date de naissance 19/10/2000
Age 23
Société GST
ID 24070512192344245

MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 12:21:16

Durée: 6mn 04s


Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

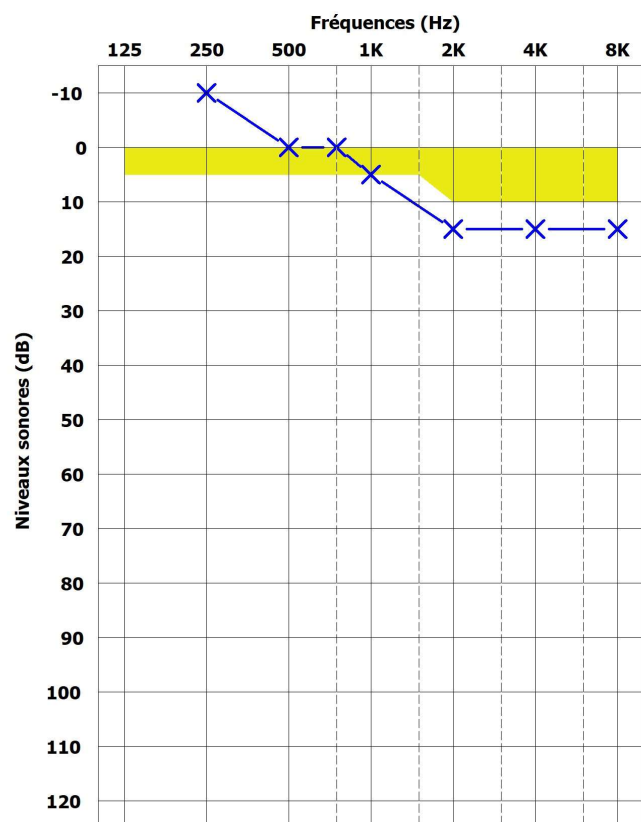

Oreille Gauche

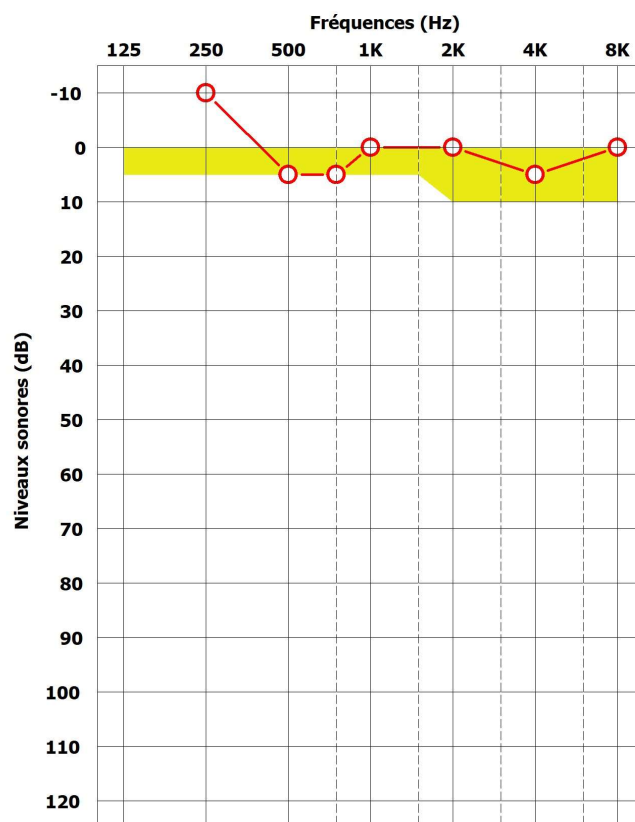

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	0	5		15		15		15
CA Droit		-10	5	5	0		0		5		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes