

MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 12:36:07

Durée: 4mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
GBOMMOU SIAKO NAPLE	
Date de naissance	06/01/1990
Age	34
Société	BCEIP
ID	24093012333654298

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

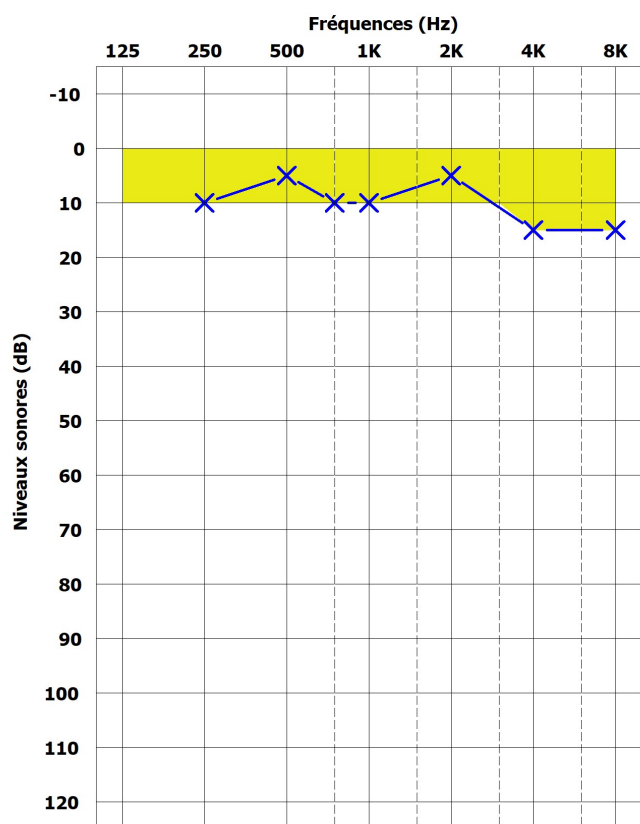

Oreille Gauche

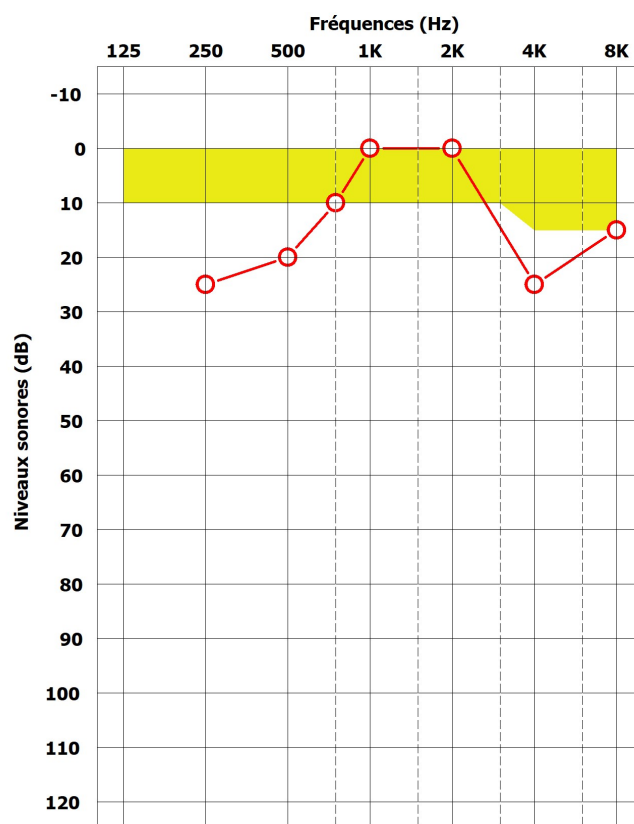

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	10	10		5		15		15
CA Droit		25	20	10	0		0		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes