

MEDVIE

Date du test: 06/05/2024 14:46:47

Durée: 6mn 24s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

BAMBA SIDIKI

Date de naissance 04/05/1980

Age 44

Société BCEIP/270


ID 24050614440426200

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

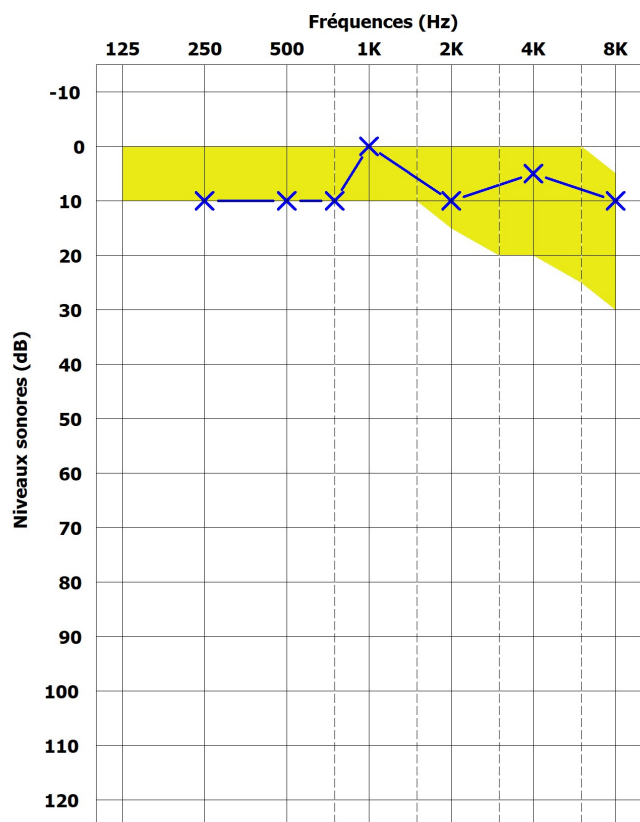

Oreille Gauche

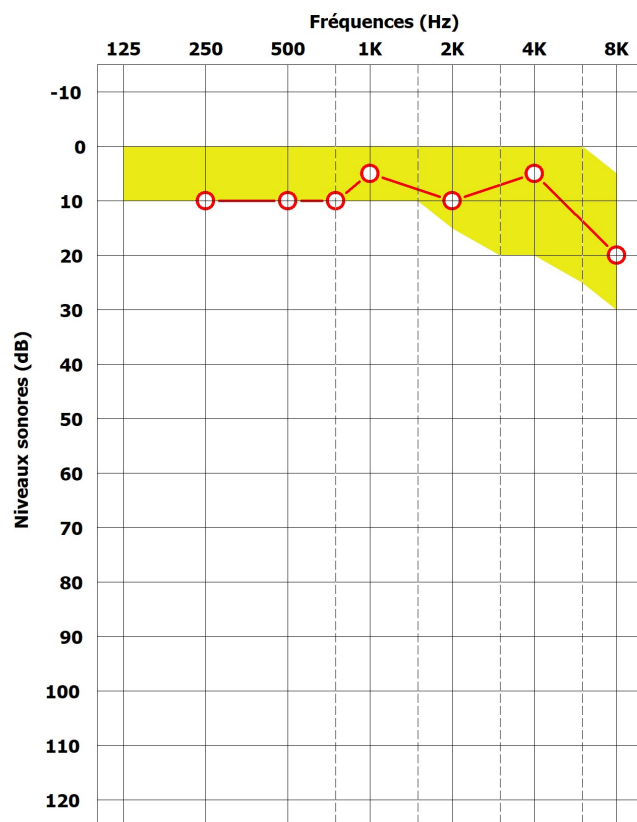

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	0		10		5		10
CA Droit		10	10	10	5		10		5		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes