


MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 12:53:29
Durée: 12mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUKOURE KARAMO	
Date de naissance	01/01/1980
Age	44
Société	BCEIP
ID	24032812505504894

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

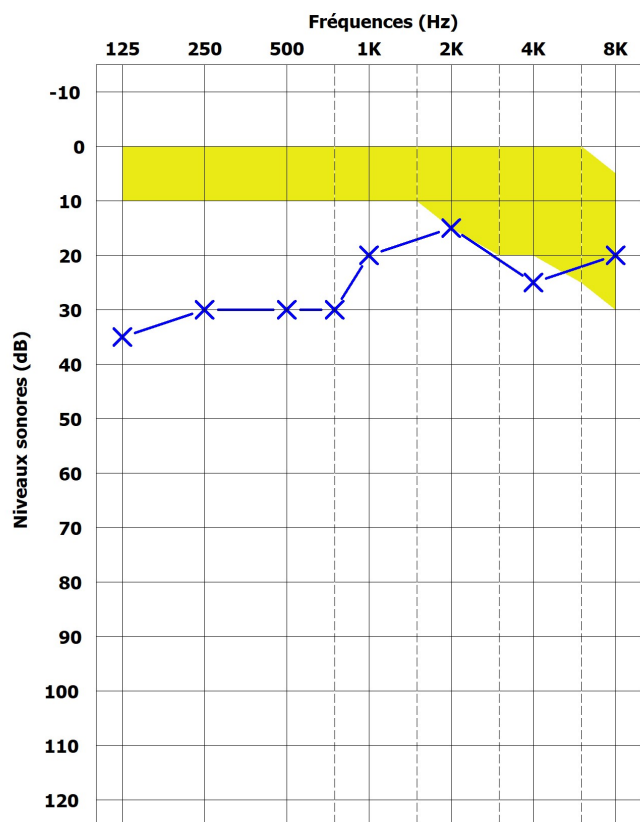

Oreille Gauche

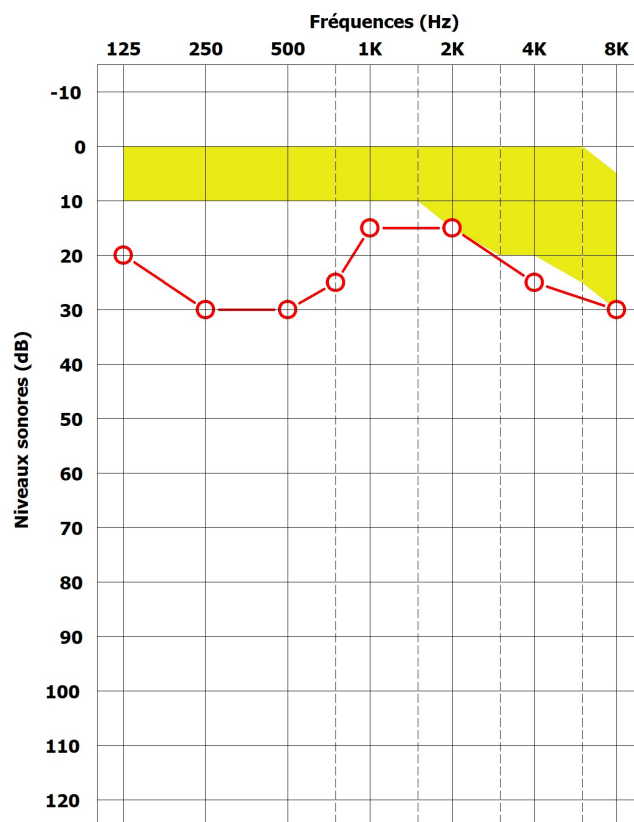

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	30	30	30	20		15		25		20
CA Droit	20	30	30	25	15		15		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes