



Données Patient


DIALLO SAIDOU

Date de naissance 31/01/1993
Age 31
Société BCEIP
ID 24071118170087480


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 11/07/2024 18:18:50
Durée: 2mn 47s
Type test Manuel
Continu

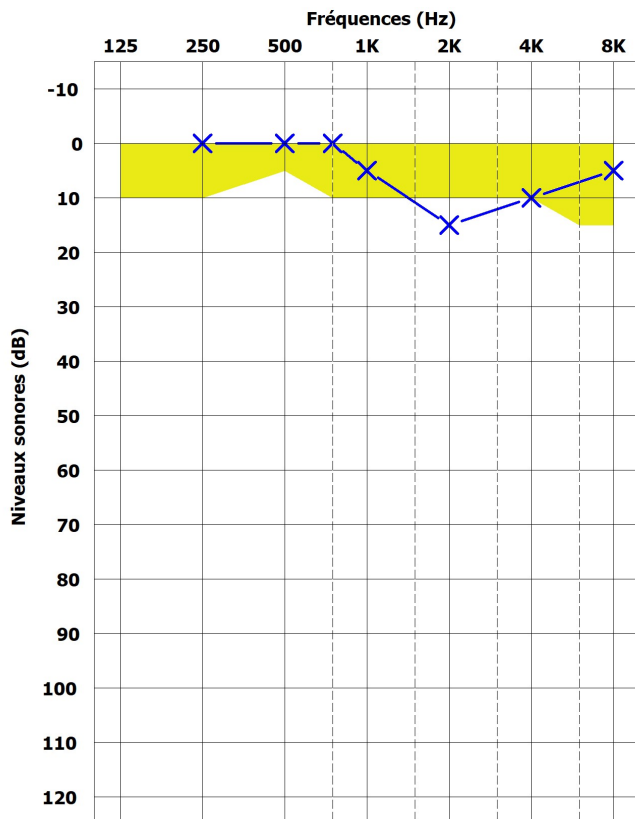

Oreille Gauche

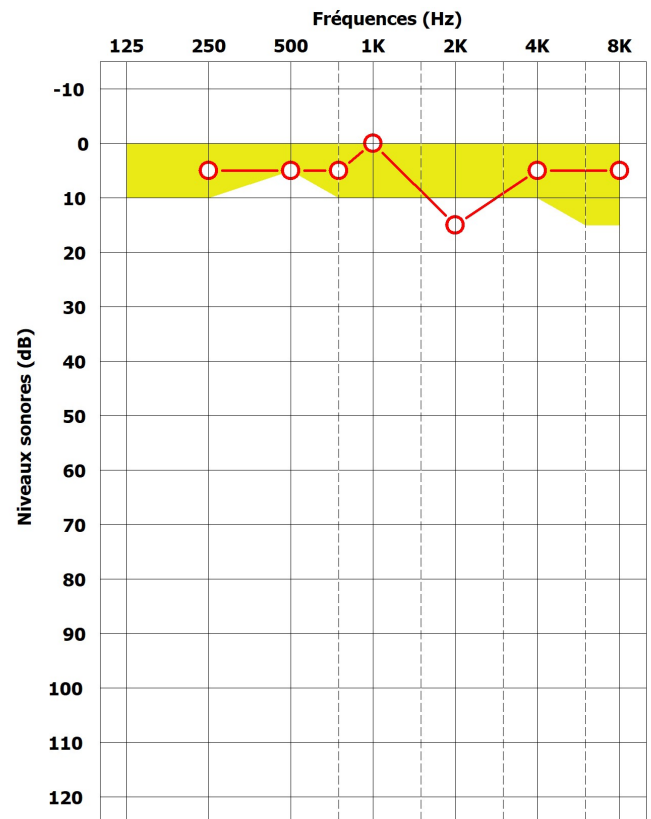

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0	0	5		15		10		5
CA Droit		5	5	5	0		15		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes