


MEDVIE

Date du test: 29/03/2024 09:41:33

Durée: 6mn 22s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

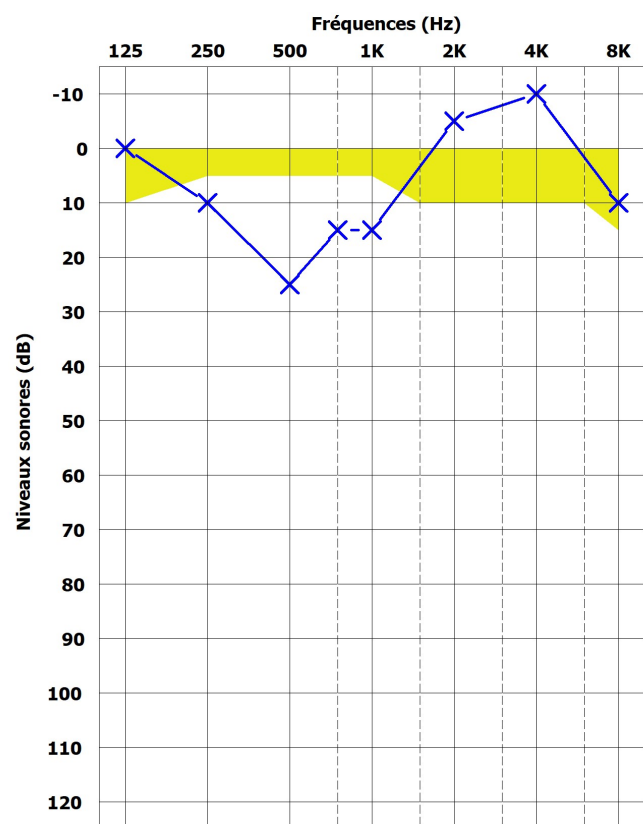

Oreille Gauche

Données Patient		CAMARA SEKOU
Date de naissance	21/11/1994	
Age	29	
Société	BCEIP	
ID	24032909361680386	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

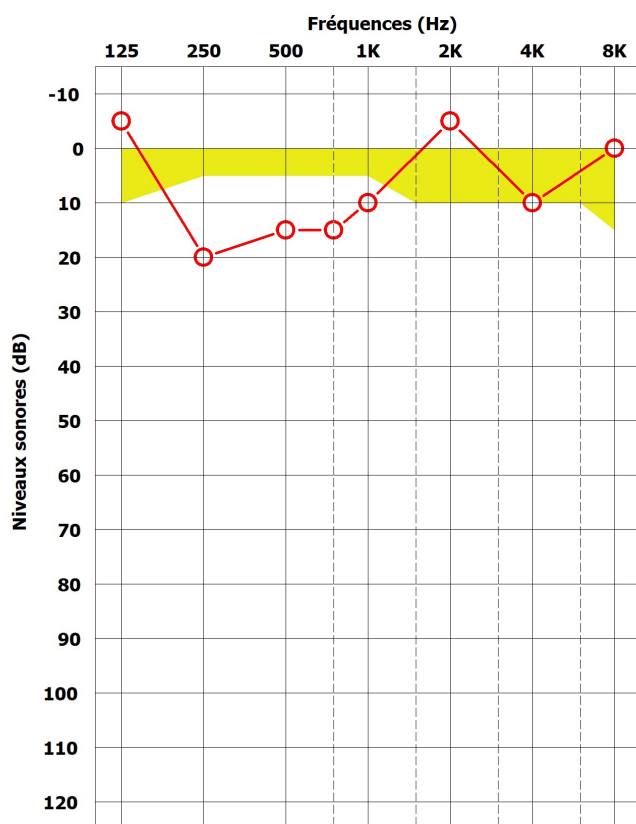

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	0	10	25	15	15		-5		-10		10
CA Droit	-5	20	15	15	10		-5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes