


MEDVIE


Date du test: 16/09/2024 12:30:41

Durée: 3mn 30s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

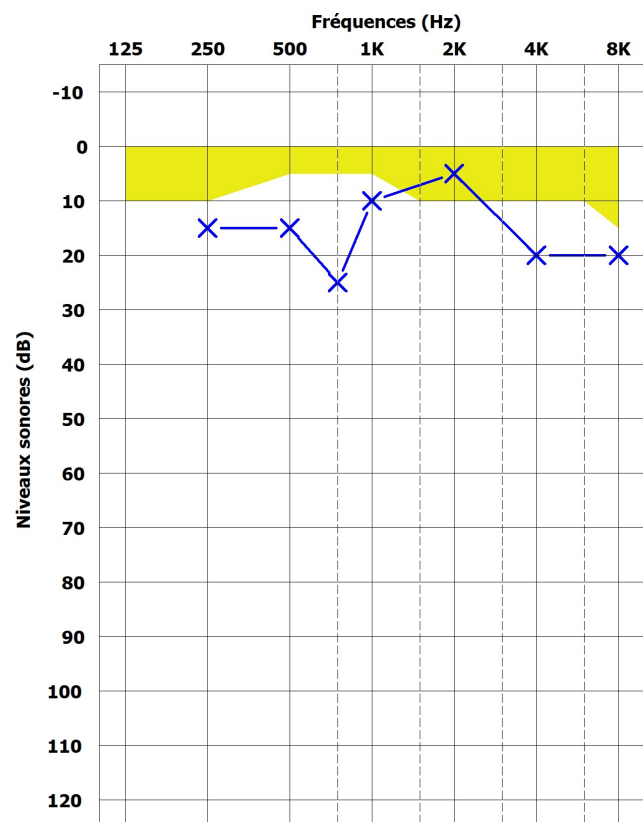

Oreille Gauche

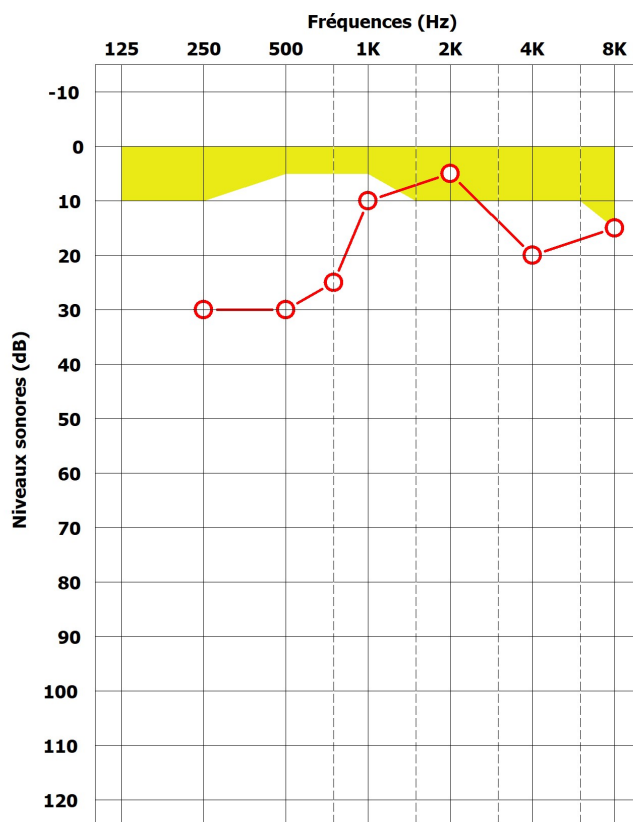

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	25	10		5		20		20
CA Droit		30	30	25	10		5		20		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient	HABA N'YEREKE
Date de naissance	02/02/1994
Age	30
Société	BCEIP
ID	24091612195969305

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021