

MEDVIE


Date du test: 07/05/2024 15:17:13

Durée: 4mn 58s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KANTE SACKO	
Date de naissance	18/01/1993
Age	31
Société	BCEIP
ID	24050715134402332

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

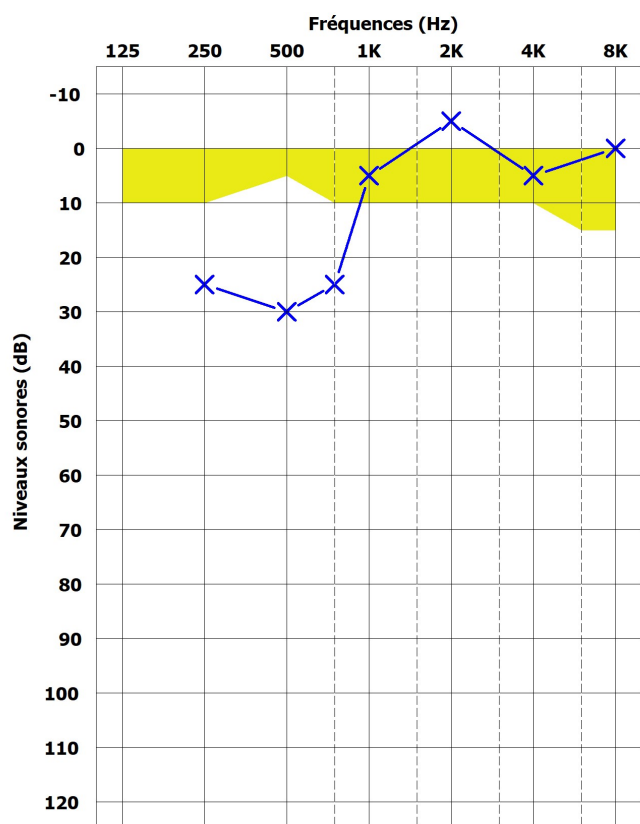

Oreille Gauche

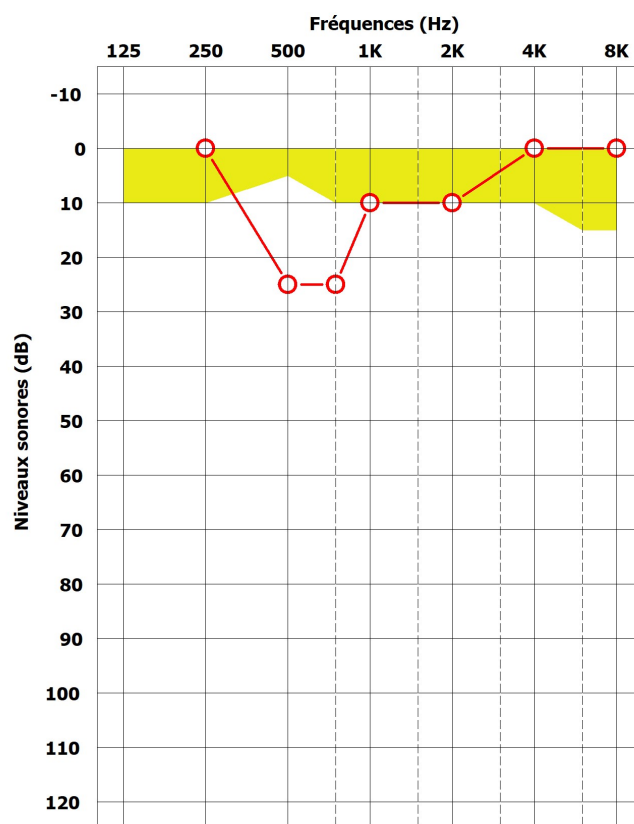

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	5		-5		5		0
CA Droit		0	25	25	10		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes