


MEDVIE

Date du test: 28/03/2024 14:24:06

Durée: 4mn 43s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

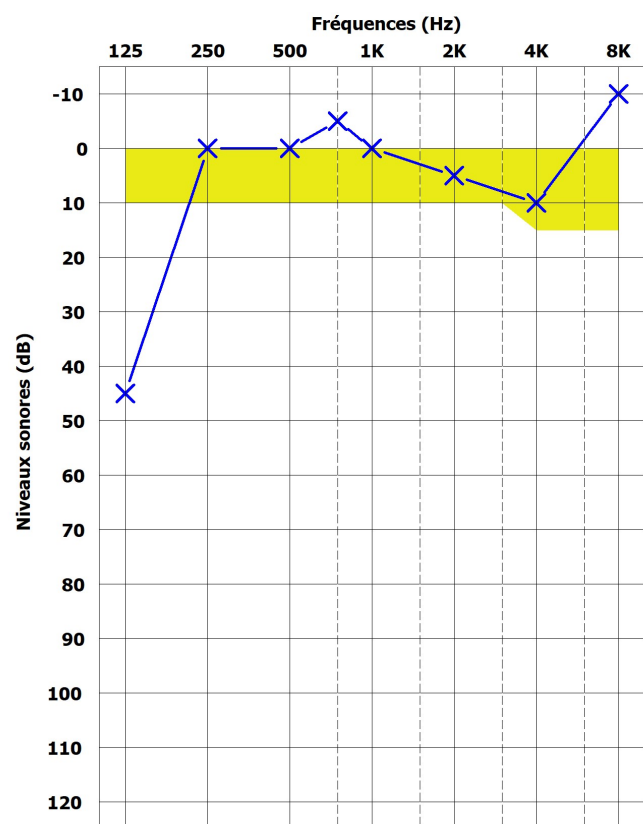

Oreille Gauche

Données Patient	
KONATE MAMOUDOU	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	BCEIP
ID	24032814204343307

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

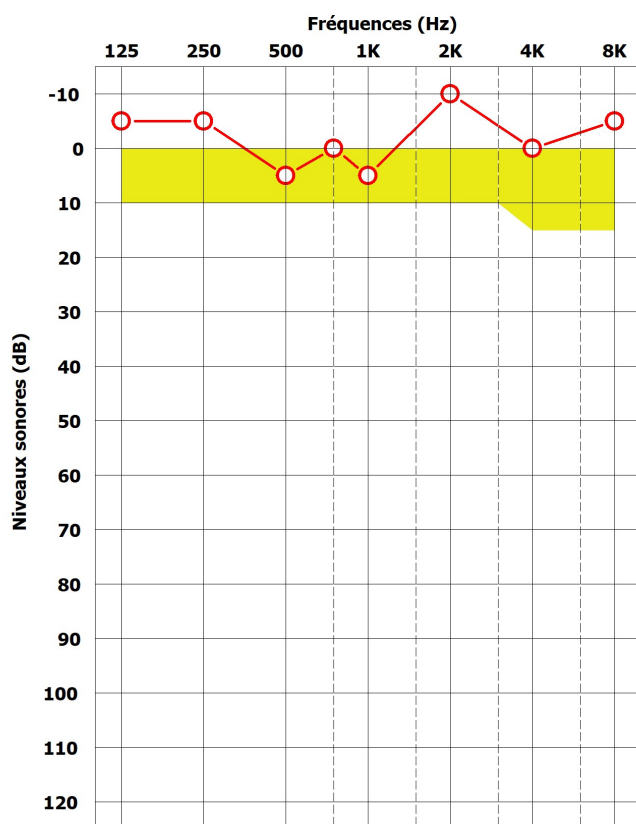

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	0	0	-5	0		5		10		-10
CA Droit	-5	-5	5	0	5		-10		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes