


MEDVIE

Date du test: 05/07/2024 16:08:55

Durée: 6mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

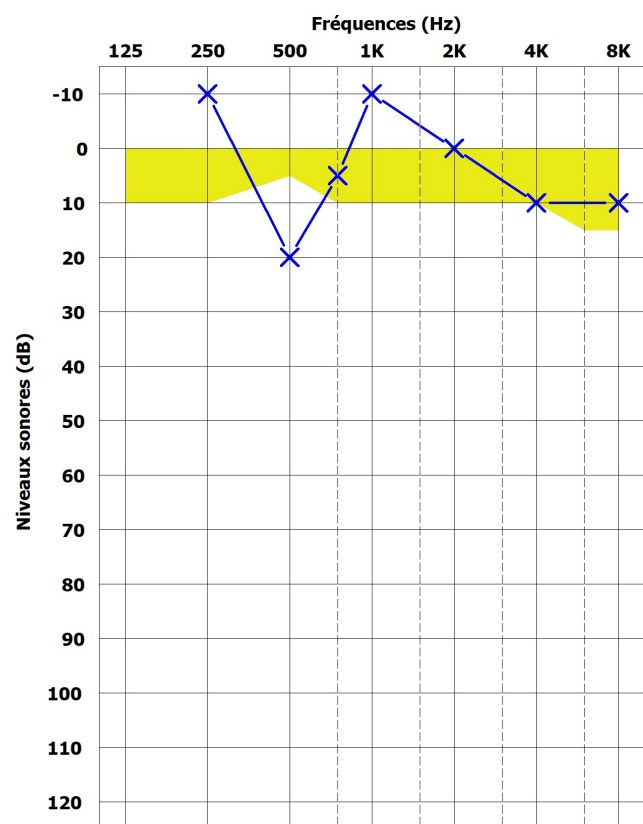

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA KOMBO	
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	BCEIP
ID	24070516065336887

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

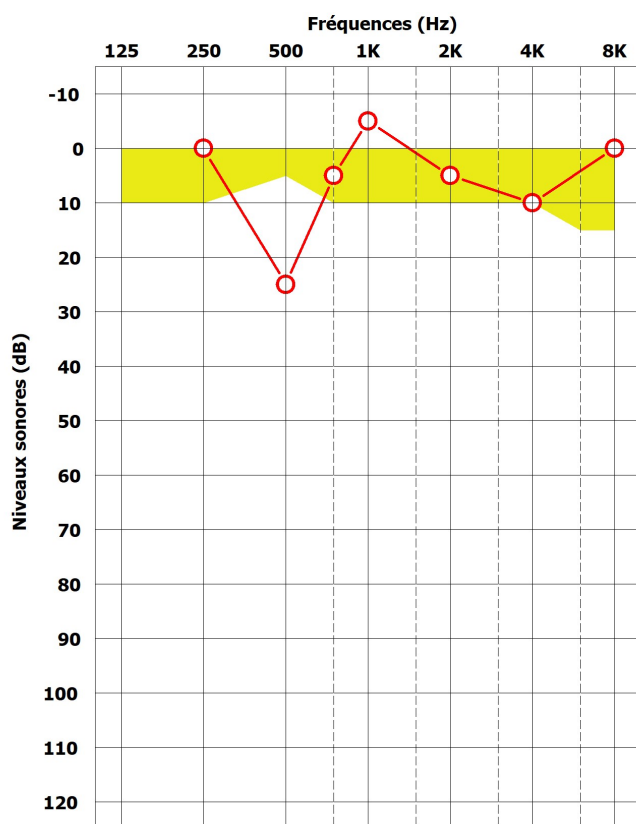

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	20	5	-10		0		10		10
CA Droit		0	25	5	-5		5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes