

MEDVIE

Date du test: 15/04/2024 09:53:58

Durée: 12mn 20s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CONDE KARIFA
NAGNOIIMA

Date de naissance 12/06/1986

Age 37

Société BECEIP


ID 24041509505640357

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

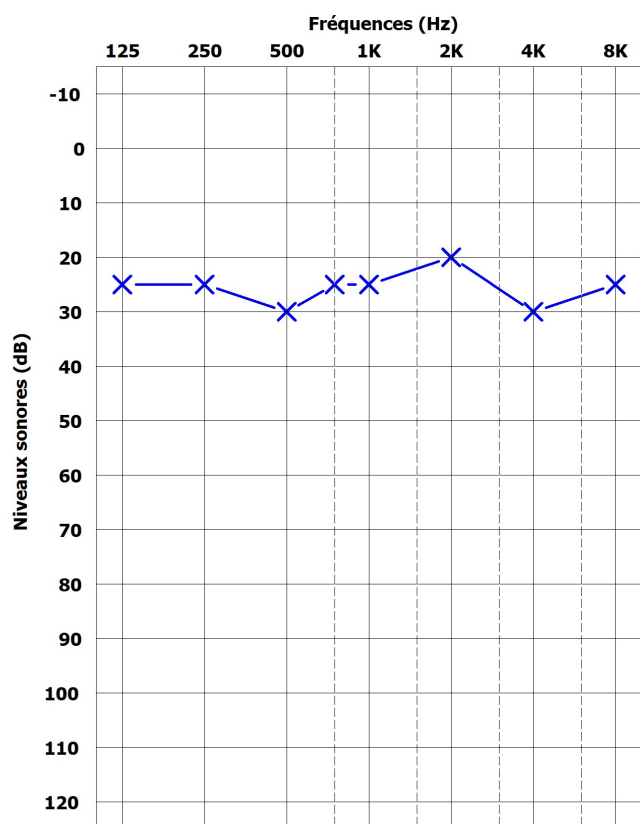

Oreille Gauche

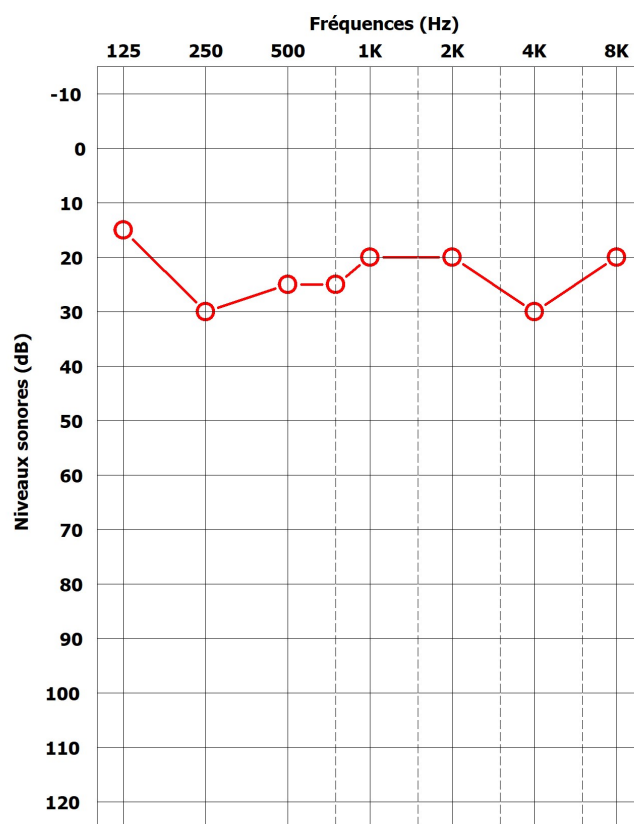

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	30	25	25		20		30		25
CA Droit	15	30	25	25	20		20		30		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes