


MEDVIE


Date du test: 03/09/2024 12:00:42

Durée: 3mn 22s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

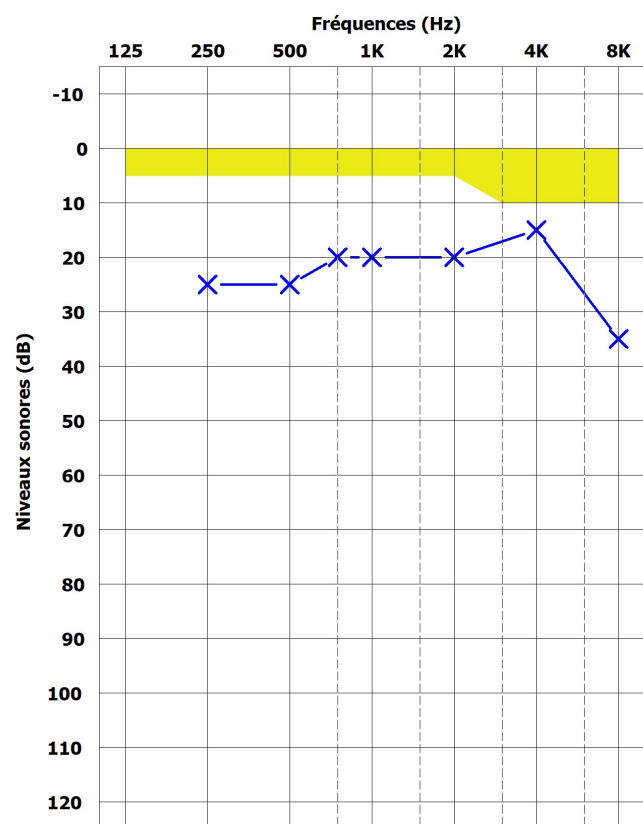

Oreille Gauche

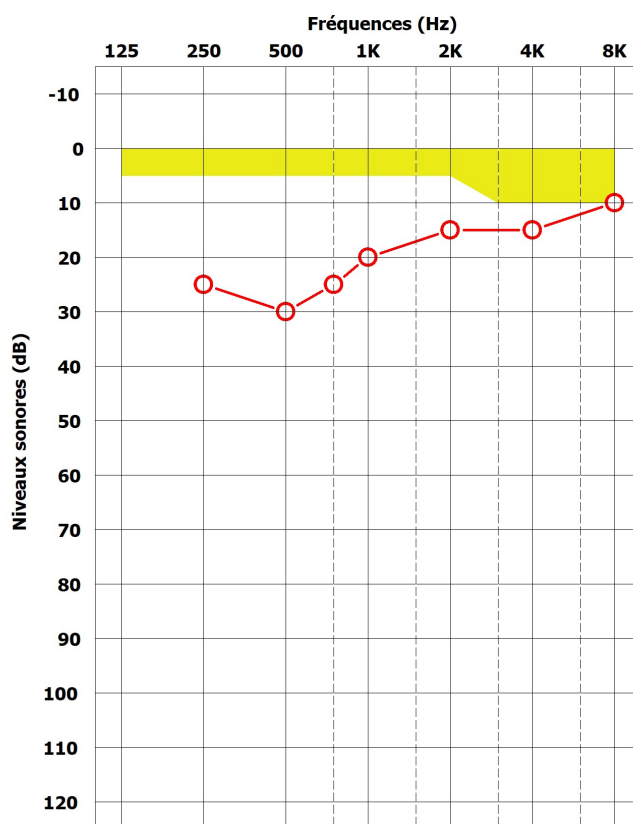

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	20	20		20		15		35
CA Droit		25	30	25	20		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	CISSE FALIKOU
Date de naissance	01/10/2003
Age	20
Société	BCEIP
ID	24090311584602685

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021