


MEDVIE


Date du test: 04/11/2024 10:45:40

Durée: 4mn 42s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

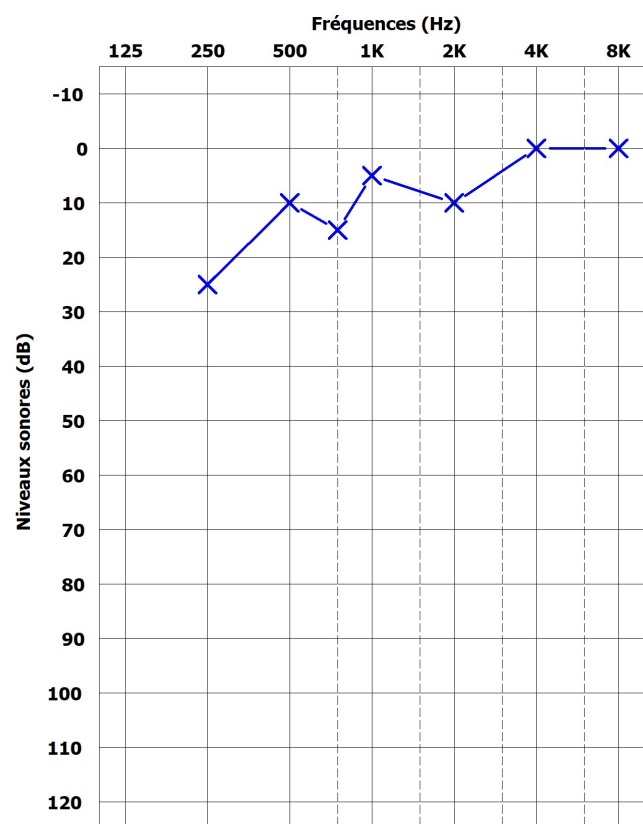

Oreille Gauche

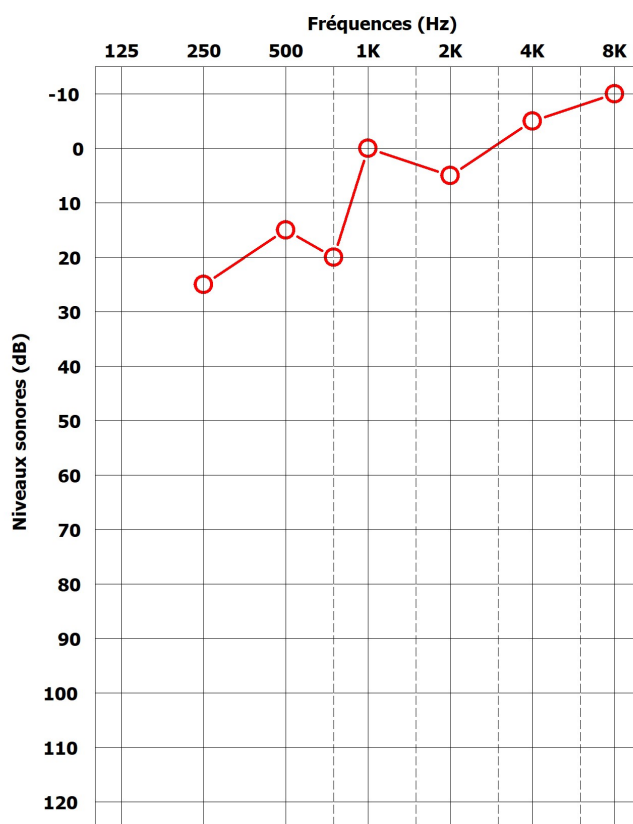

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	15	5		10		0		0
CA Droit		25	15	20	0		5		-5		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient

KOUROUMA ANSOUMANE

Date de naissance

01/07/1994

Age

30

Société

BCEIP

ID

24110410250969783

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021