

MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 18:21:56

Durée: 4mn 32s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRAORE ABOU
Date de naissance	01/01/1993	
Age	31	
Société	BCEIP/288	
ID	24050618201500436	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

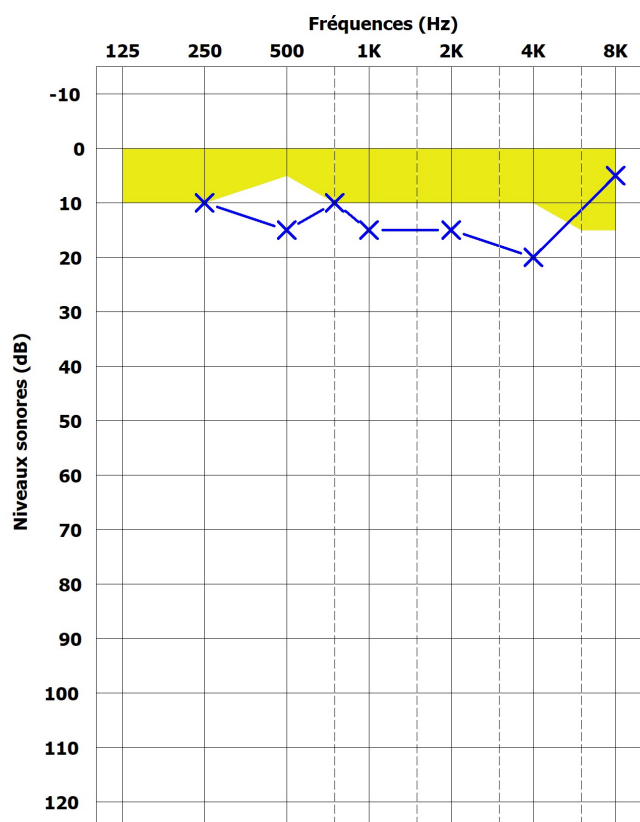

Oreille Gauche

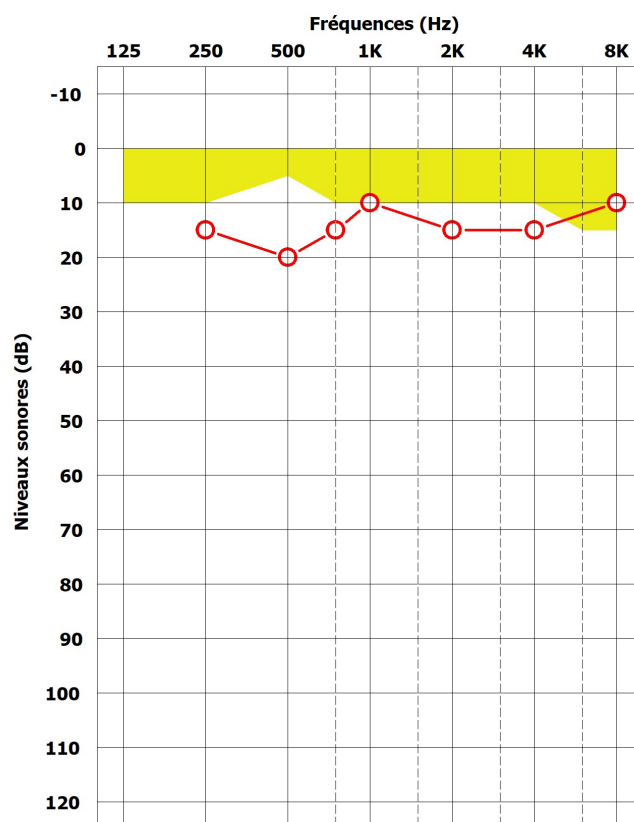

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	15		15		20		5
CA Droit		15	20	15	10		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes