


MEDVIE


Date du test: 16/08/2024 13:00:18

Durée: 5mn 04s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

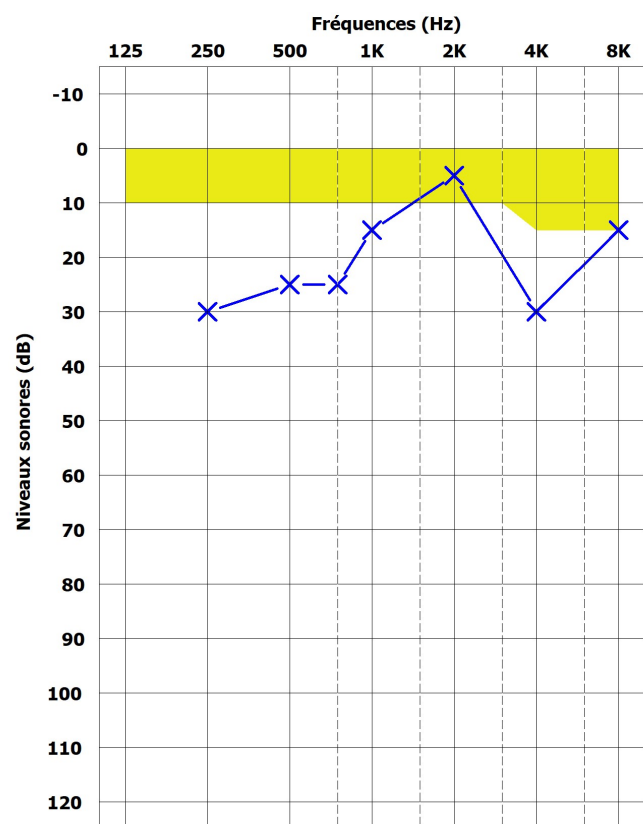

Oreille Gauche

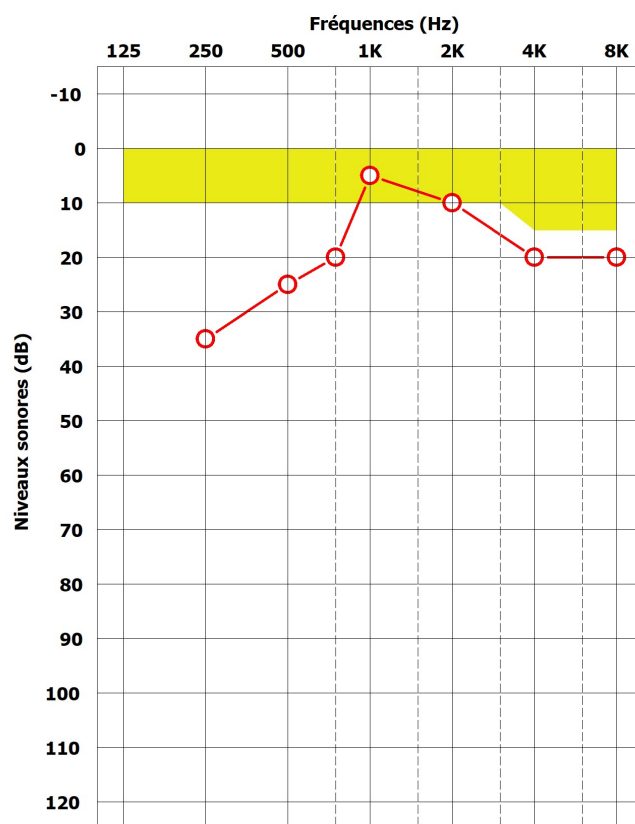

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	15		5		30		15
CA Droit		35	25	20	5		10		20		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	KAMANO JOSEPH
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	BCEIP
ID	24081612573848962

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021