

MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 14:56:43

Durée: 5mn 13s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BAH OUMAR
Date de naissance	10/03/1993
Age	31
Société	BCEIP261
ID	24050614543996119

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

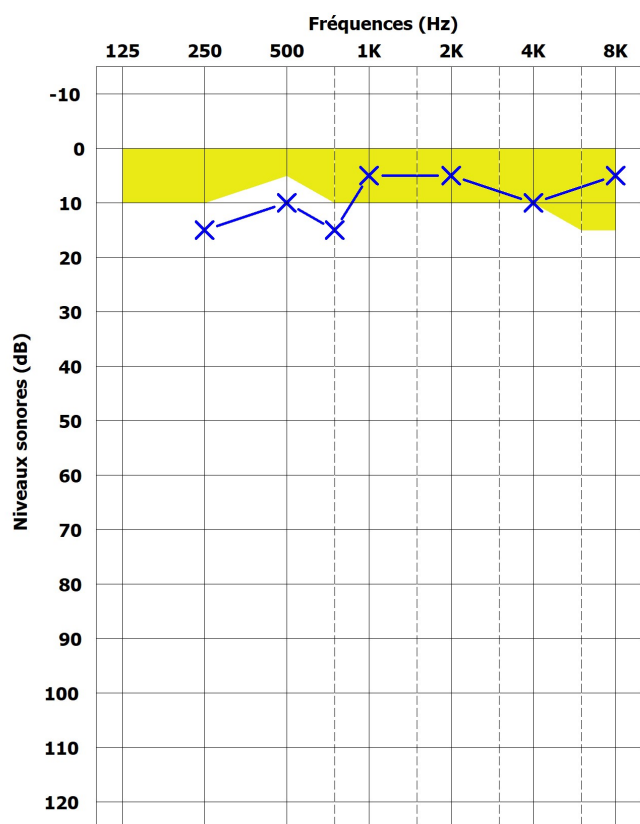

Oreille Gauche

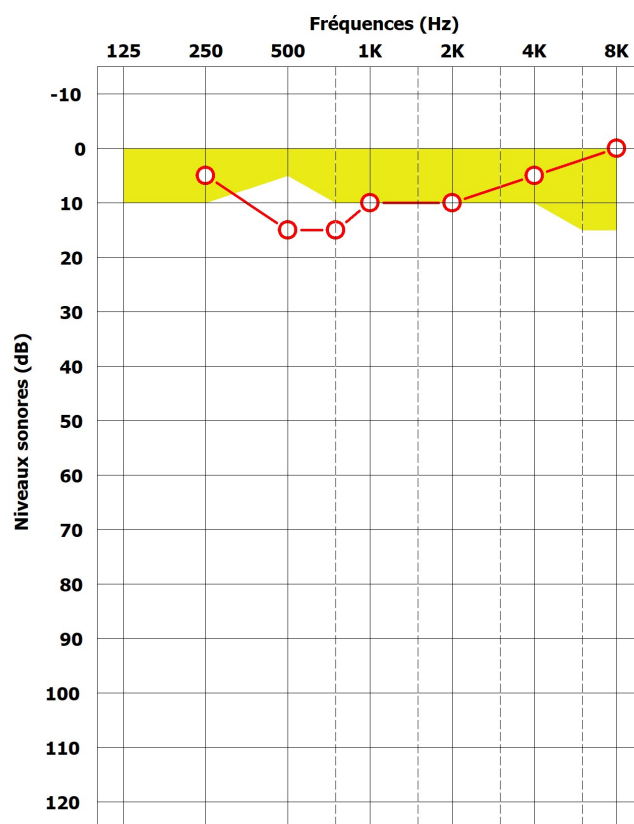

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	15	5		5		10		5
CA Droit		5	15	15	10		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes