


MEDVIE

Date du test: 28/03/2024 08:28:15

Durée: 1mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

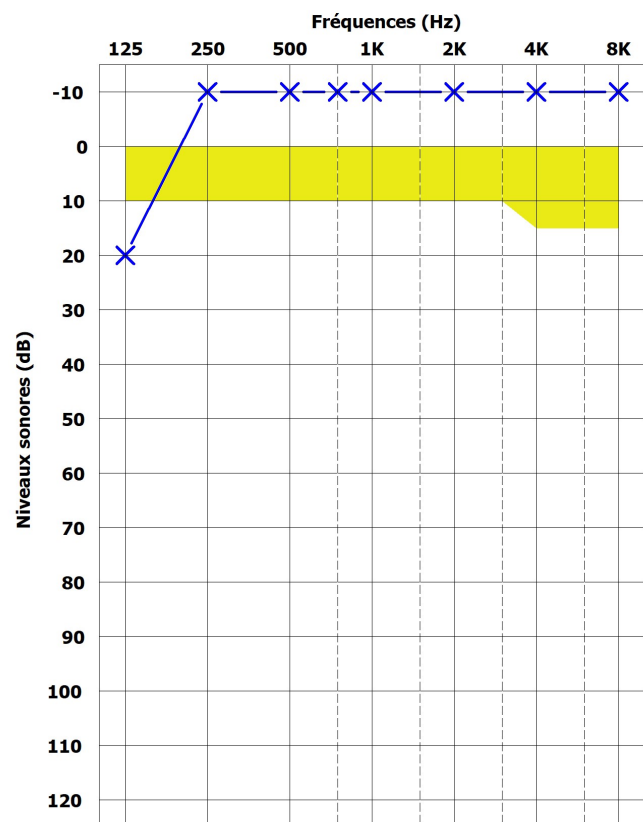

Oreille Gauche

Données Patient		TRAORE Idrissa
Date de naissance	10/10/1989	
Age	34	
Société	bceip	
ID	24032808243687078	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

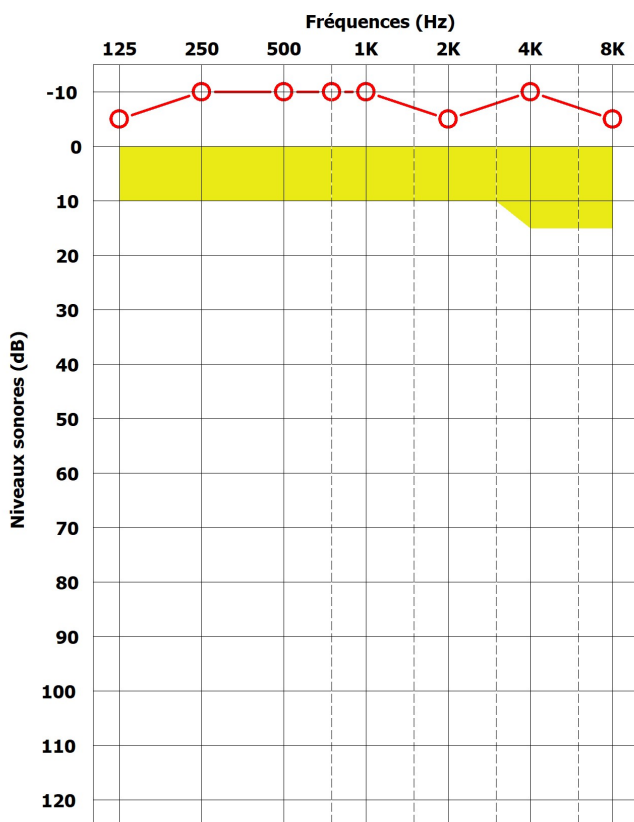

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	-10	-10	-10	-10		-10		-10		-10
CA Droit	-5	-10	-10	-10	-10		-5		-10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-10,0 dB	---
CA Droit	-8,8 dB	---

Notes