


MEDVIE


Date du test: 30/05/2024 18:05:55
Durée: 5mn 22s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA N'FALY	
Date de naissance	05/02/1970
Age	54
Société	BCEIP
ID	24053013421166561

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

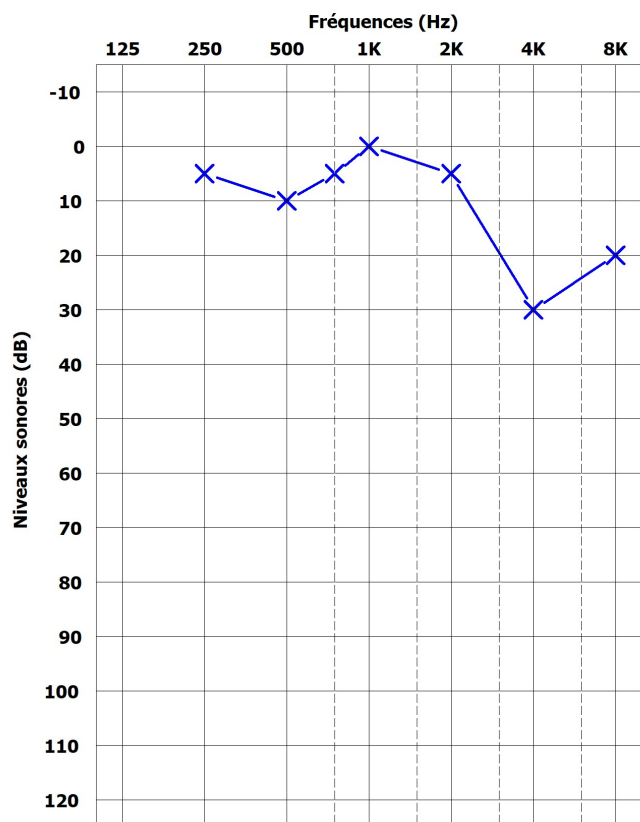

Oreille Gauche

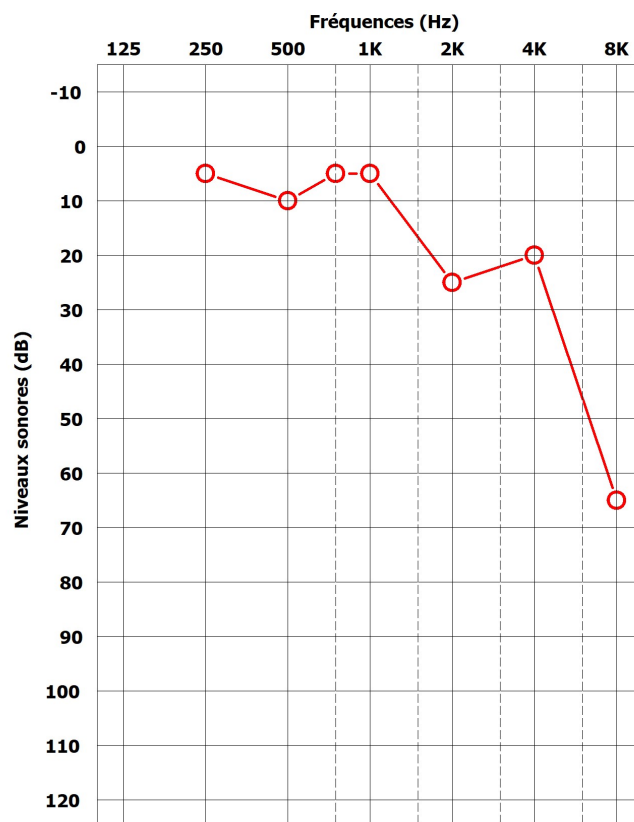

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	5	0		5		30		20
CA Droit		5	10	5	5		25		20		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes