

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 13:38:38

Durée: 7mn 48s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA MAMADY	
Date de naissance	01/01/1980
Age	44
Société	BCEIP
ID	24032813355719900

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

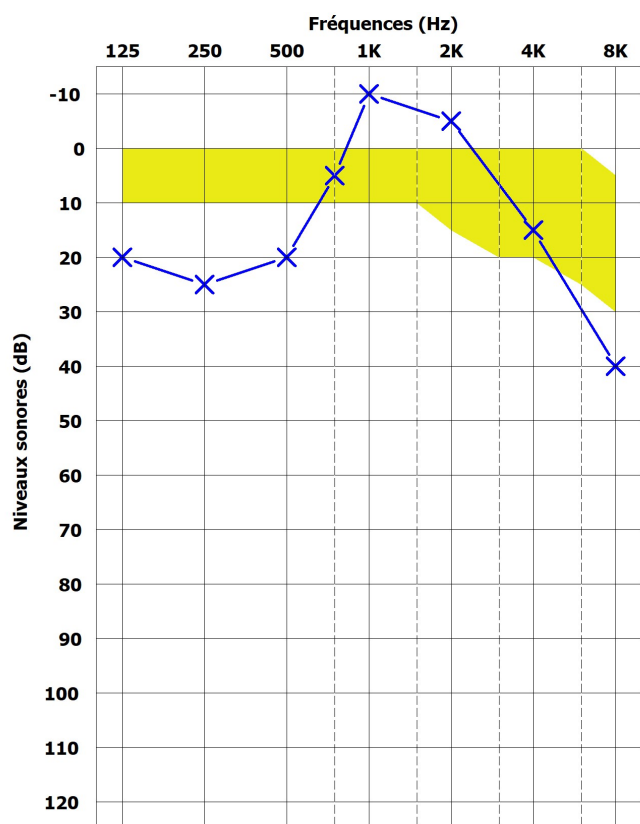

Oreille Gauche

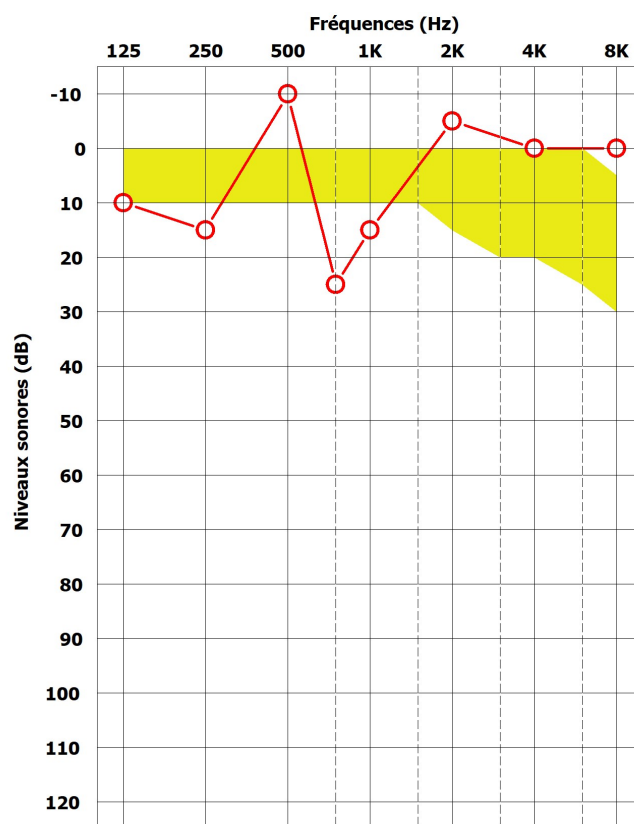

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	25	20	5	-10		-5		15		40
CA Droit	10	15	-10	25	15		-5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes