

MEDVIE


Date du test: 04/11/2024 11:01:58

Durée: 4mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KONATE MAMADOU	
Date de naissance	01/01/1983
Age	41
Société	BCEIP
ID	24110411001135654

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

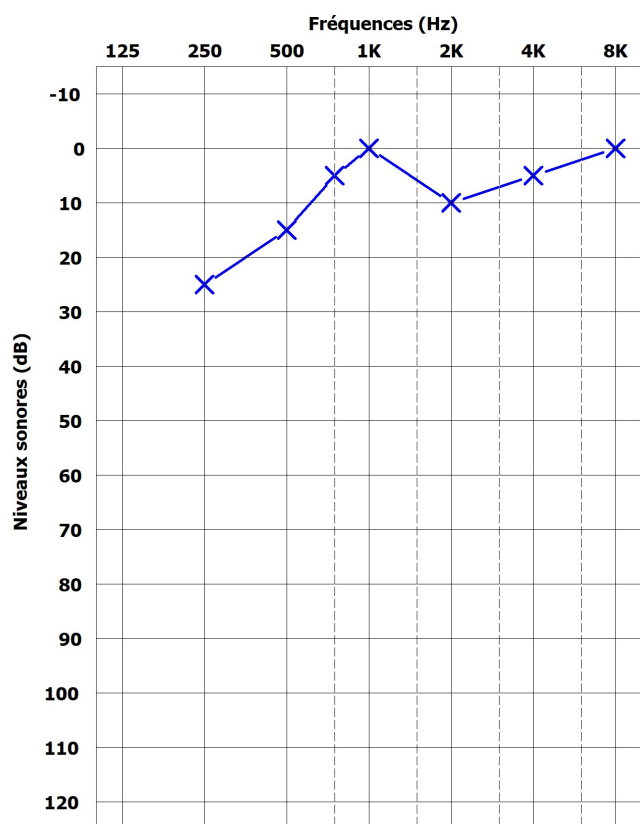

Oreille Gauche

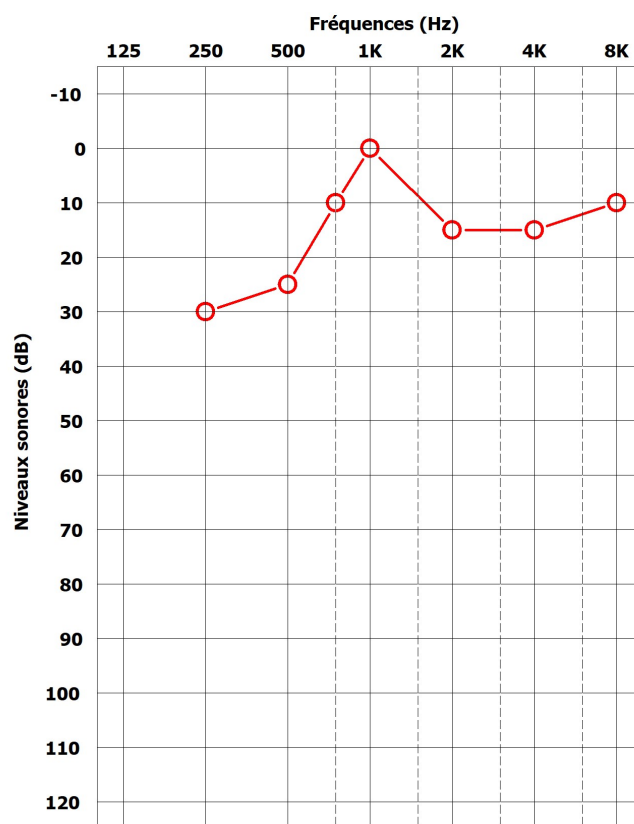

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	5	0		10		5		0
CA Droit		30	25	10	0		15		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes