

MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 12:04:29

Durée: 7mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SANGARE FACELY
Date de naissance	24/12/1988
Age	35
Société	BCEIP
ID	24041512023580595

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

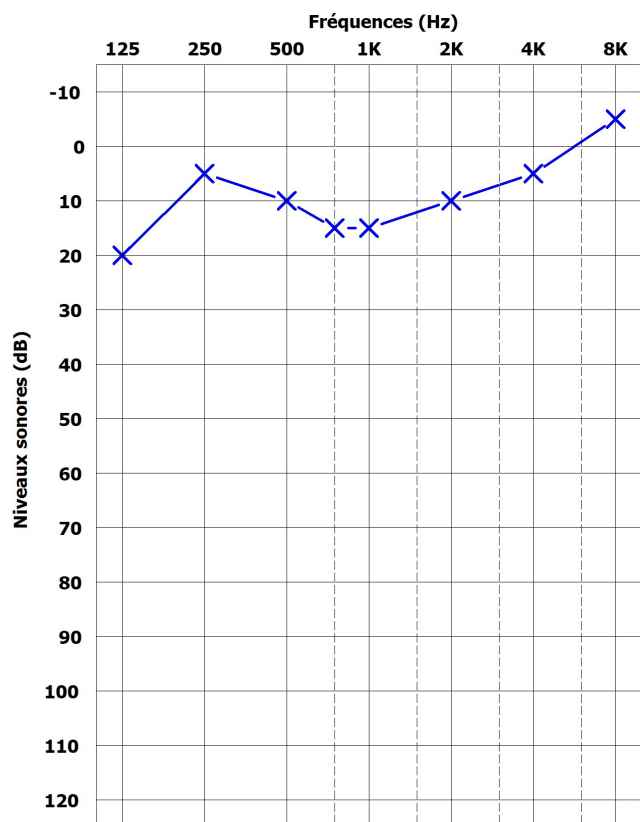

Oreille Gauche

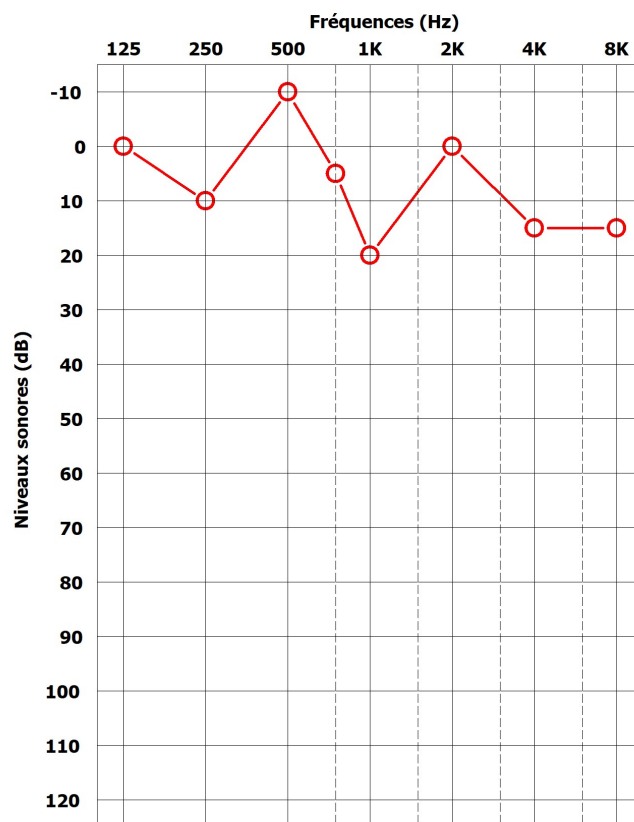

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	10	15	15		10		5		-5
CA Droit	0	10	-10	5	20		0		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes