

MEDVIE


Date du test: 07/05/2024 14:13:56

Durée: 3mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KAMARA ABRAHAM .A	
Date de naissance	06/05/1988
Age	36
Société	BCEIP
ID	24050714092902737

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

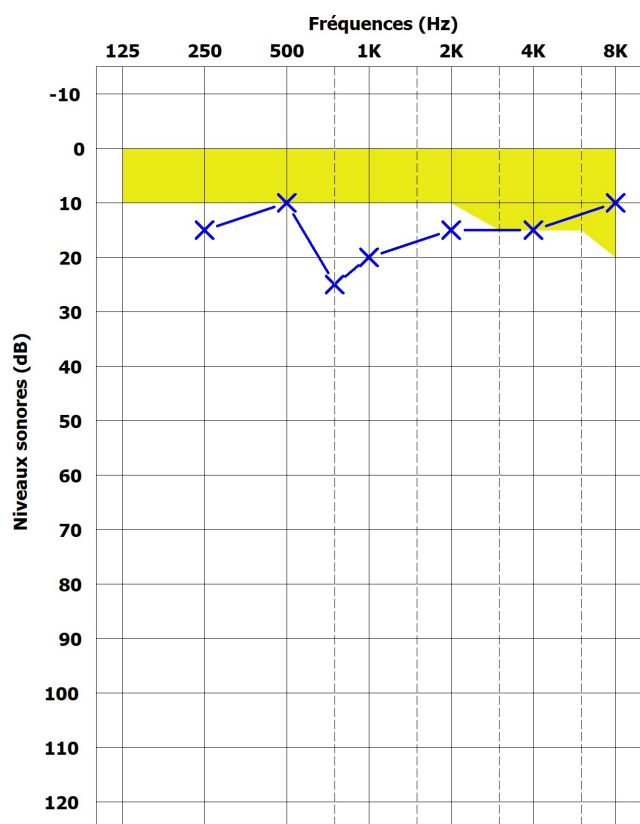

Oreille Gauche

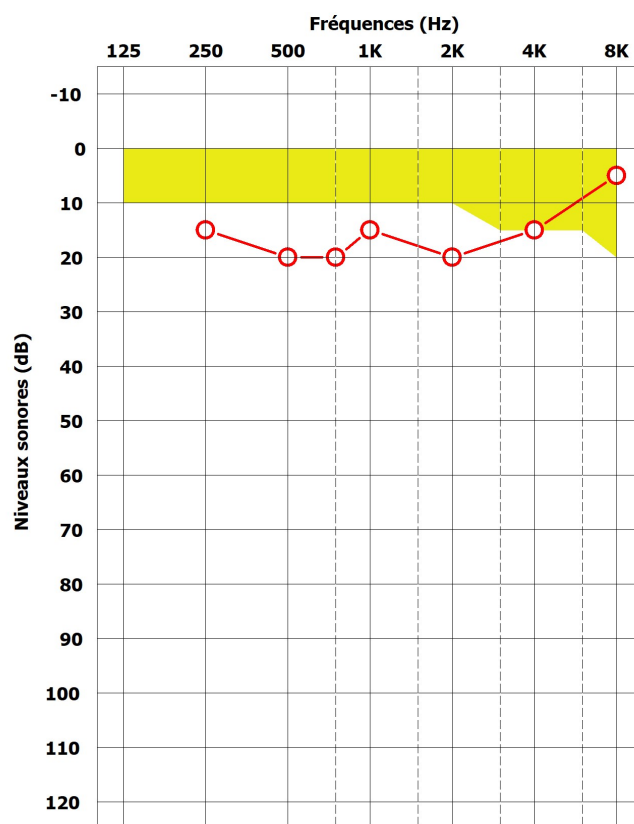

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	25	20		15		15		10
CA Droit		15	20	20	15		20		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes