

MEDVIE


Date du test: 07/05/2024 13:11:39

Durée: 4mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA Vamougna	
Date de naissance	02/02/1986
Age	38
Société	BCEIP
ID	24050713082283605

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

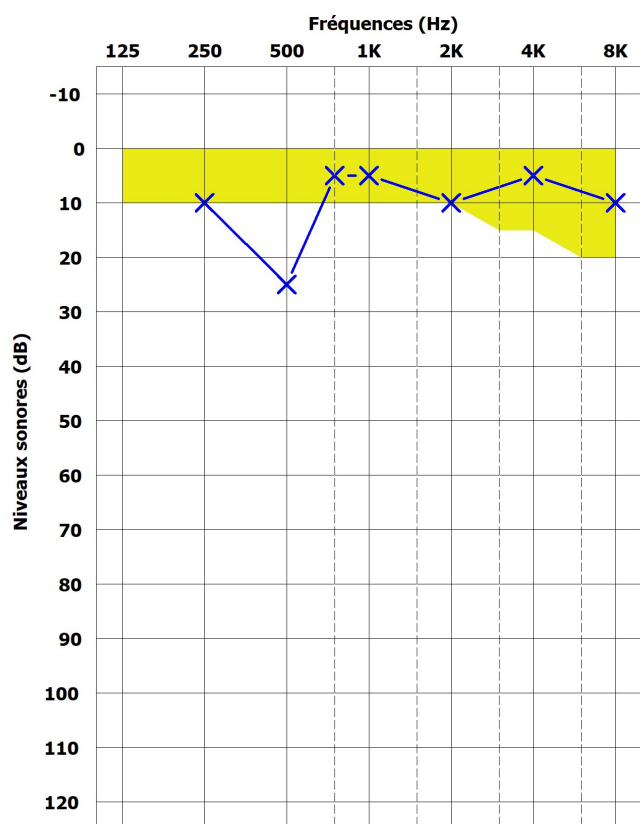

Oreille Gauche

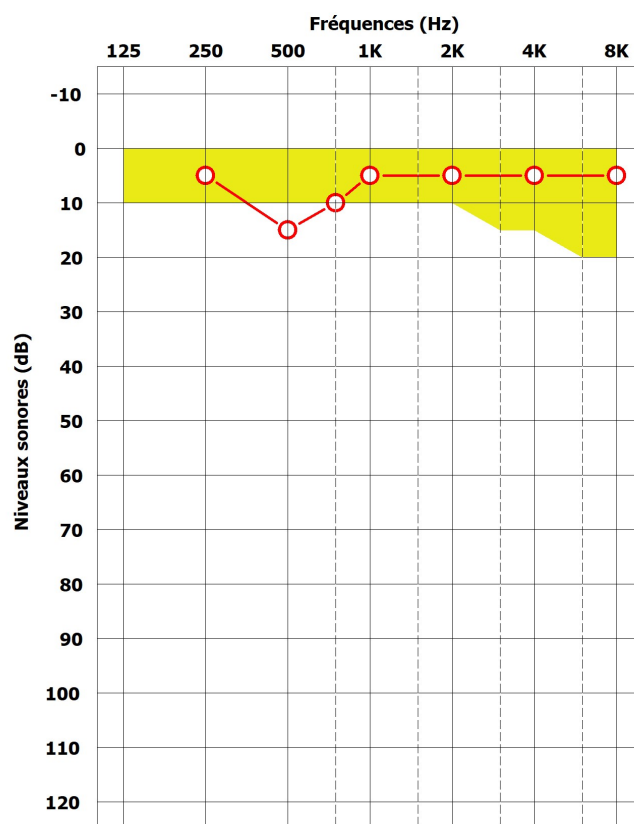

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	5	5		10		5		10
CA Droit		5	15	10	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes