


MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 17:38:16
Durée: 3mn 18s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF ANSOUMANE	
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	BCEIP/294
ID	24050617364201043

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

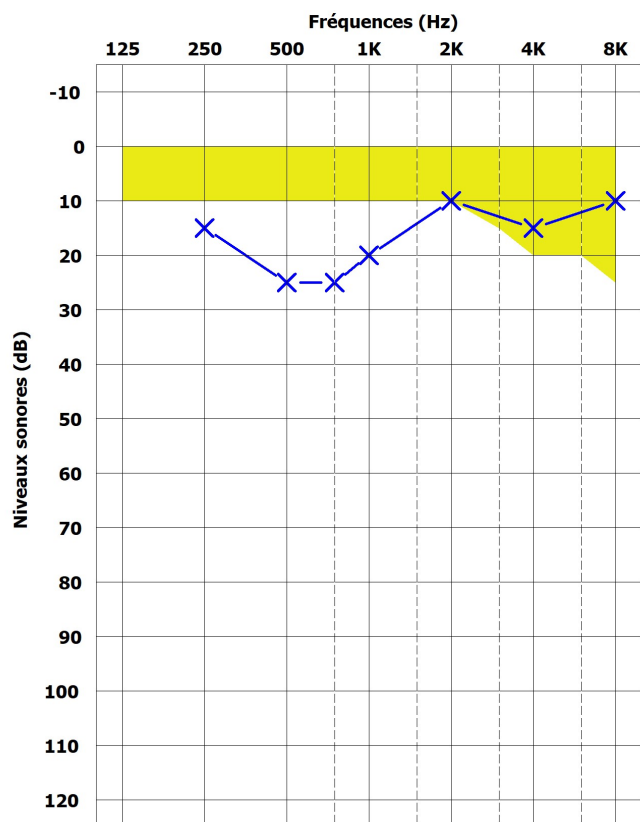

Oreille Gauche

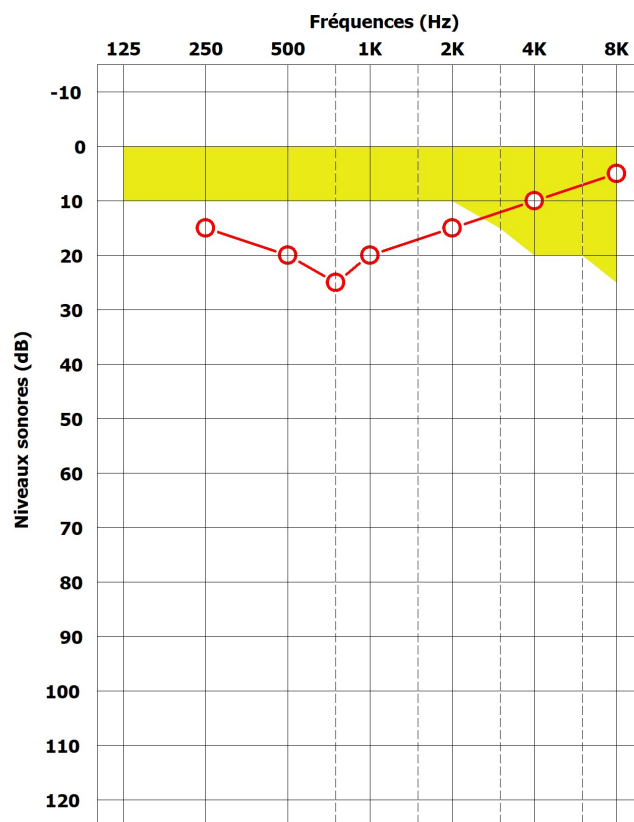

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	25	20		10		15		10
CA Droit		15	20	25	20		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes