


MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 13:55:39  
Durée: 5mn 15s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SANGARE ALHASSANE |                   |
| Date de naissance | 20/02/1990        |
| Age               | 34                |
| Société           | BCEIP             |
| ID                | 24070513533946354 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

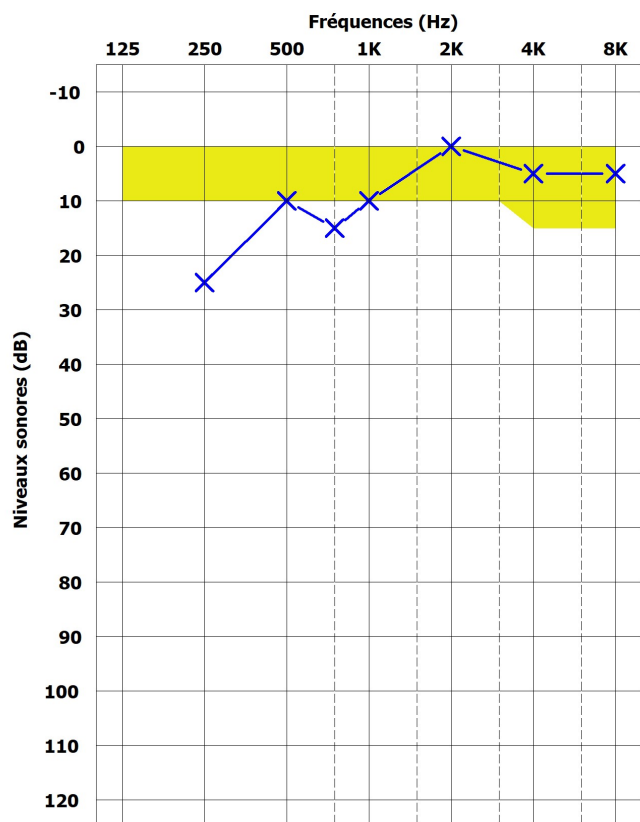

Oreille Gauche

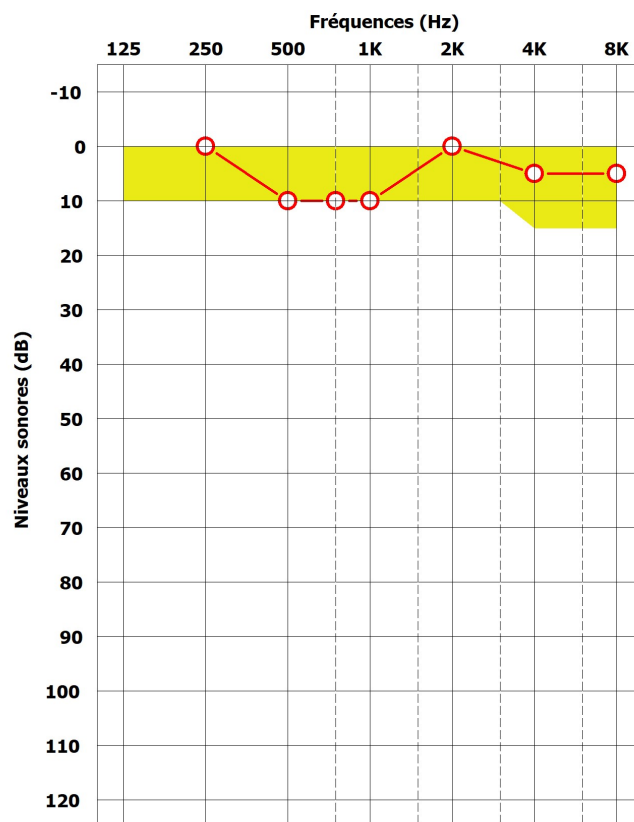

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 10  | 15  | 10 |     | 0  |    | 5  |    | 5  |
| CA Droit  |     | 0   | 10  | 10  | 10 |     | 0  |    | 5  |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 6,3 dB | --- |
| CA Droit        | 6,3 dB | --- |

Notes