

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 09:37:29

Durée: 9mn 49s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1980
Age	44
Société	BCEIP
ID	24032809342999591

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

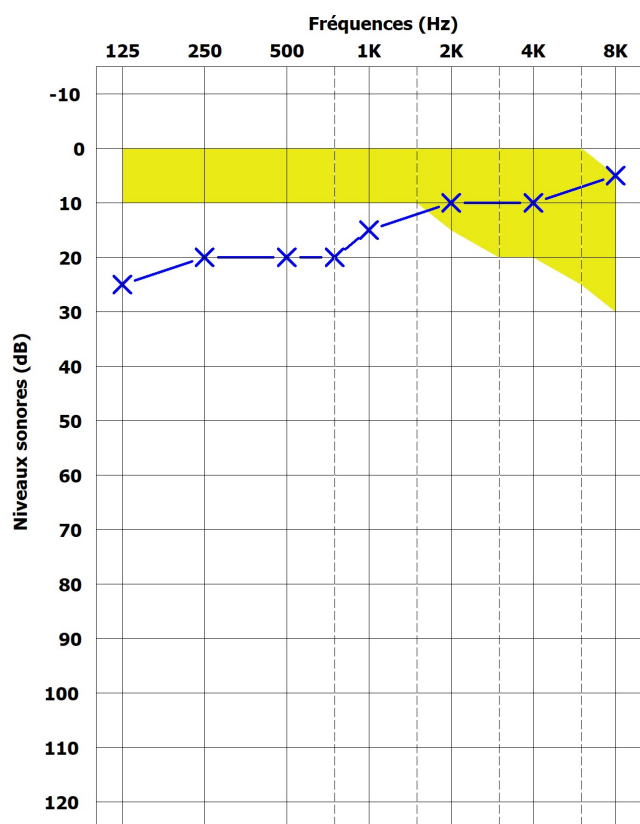

Oreille Gauche

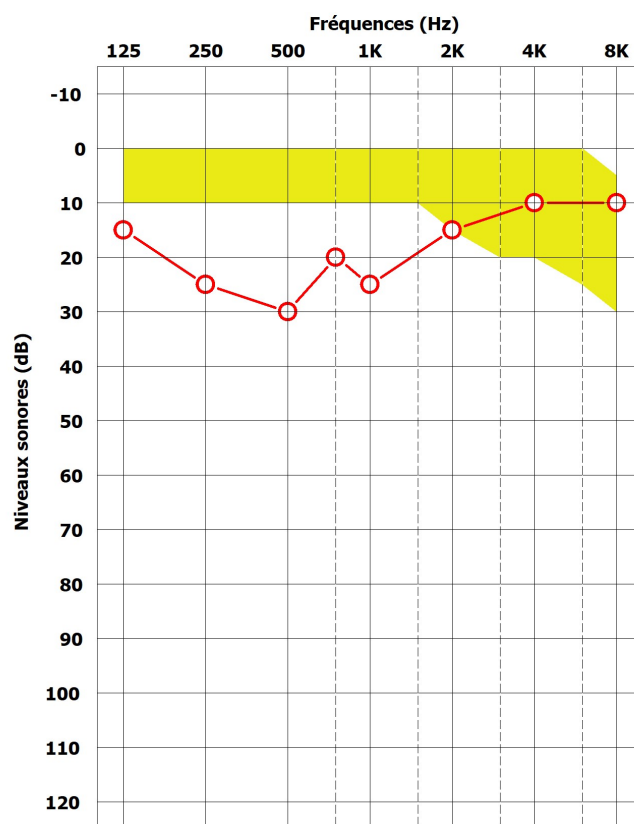

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	20	15		10		10		5
CA Droit	15	25	30	20	25		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes