

MEDVIE

Date du test: 08/07/2024 13:27:55

Durée: 4mn 13s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **SANGARE SOULEYMANE**

Date de naissance 05/01/1991

Age 33

Société BCEIP


ID 24070813252596127

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

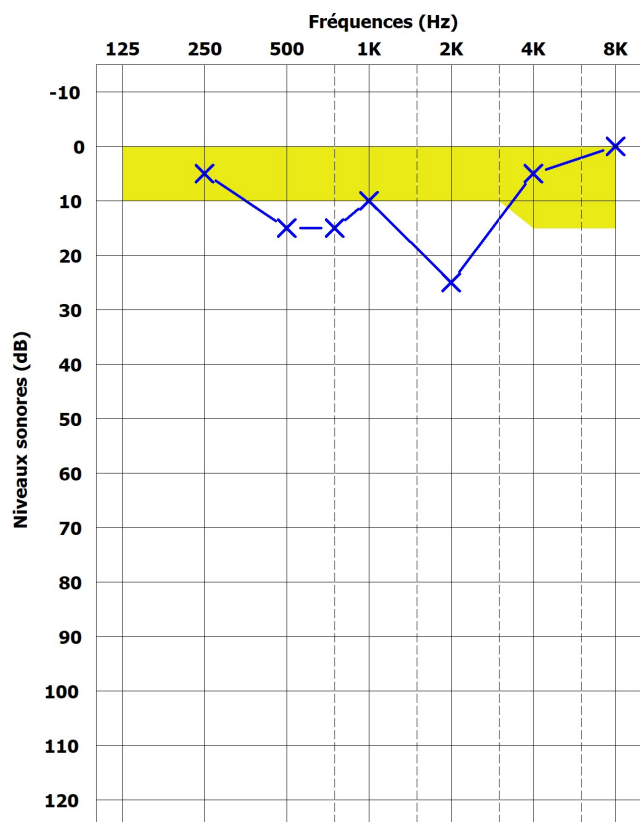

Oreille Gauche

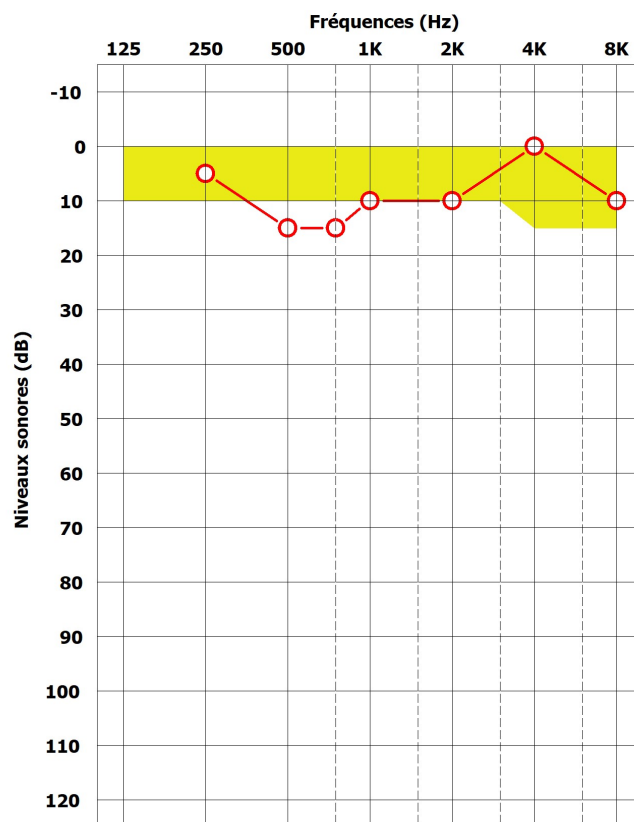

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	15	10		25		5		0
CA Droit		5	15	15	10		10		0		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes