


MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 08:49:28
Durée: 9mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA Ousmane	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	BCEIP
ID	24032808424799257

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

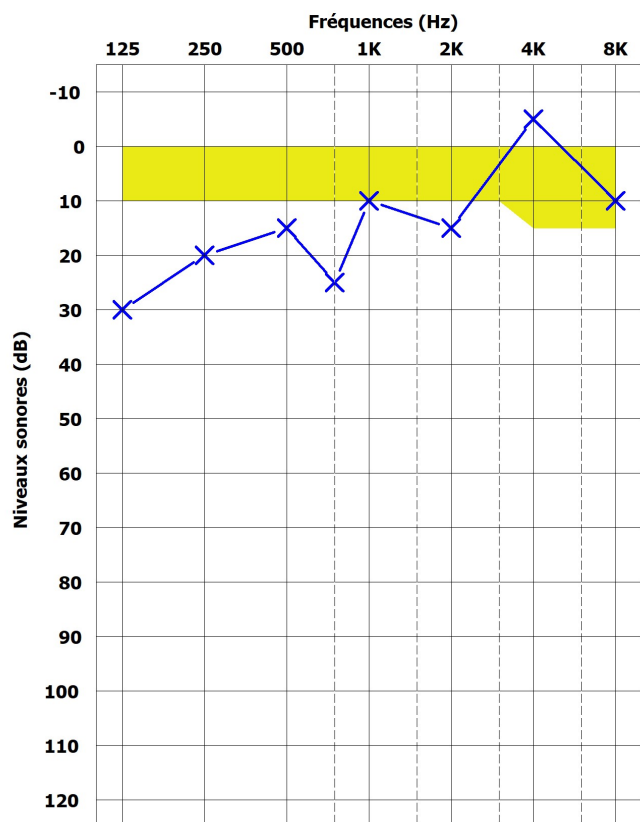

Oreille Gauche

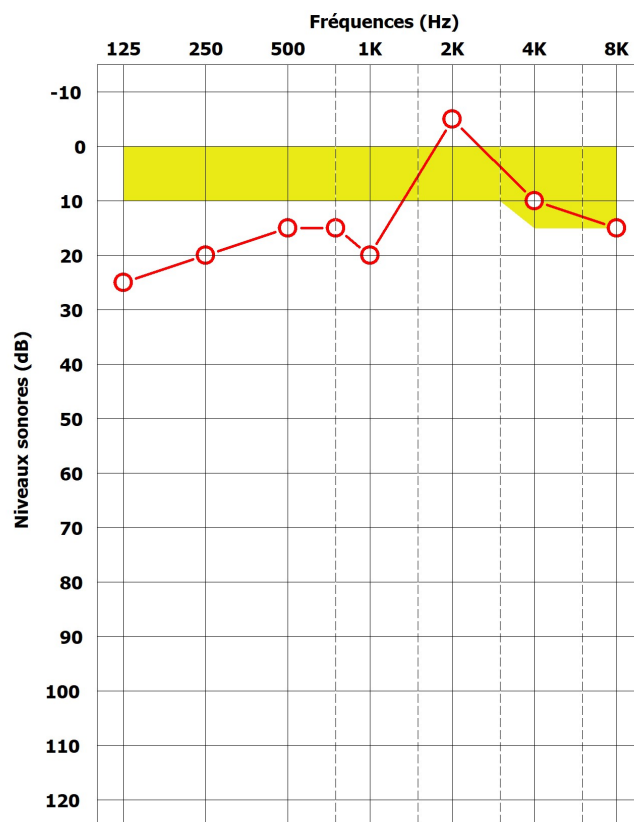

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	15	25	10		15		-5		10
CA Droit	25	20	15	15	20		-5		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes