

MEDVIE

Date du test: 09/08/2024 13:08:17

Durée: 10mn 38s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CISSE NOUHA

Date de naissance

07/06/1976

Age

48

Société

BCEIP

ID

24080913005189832

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

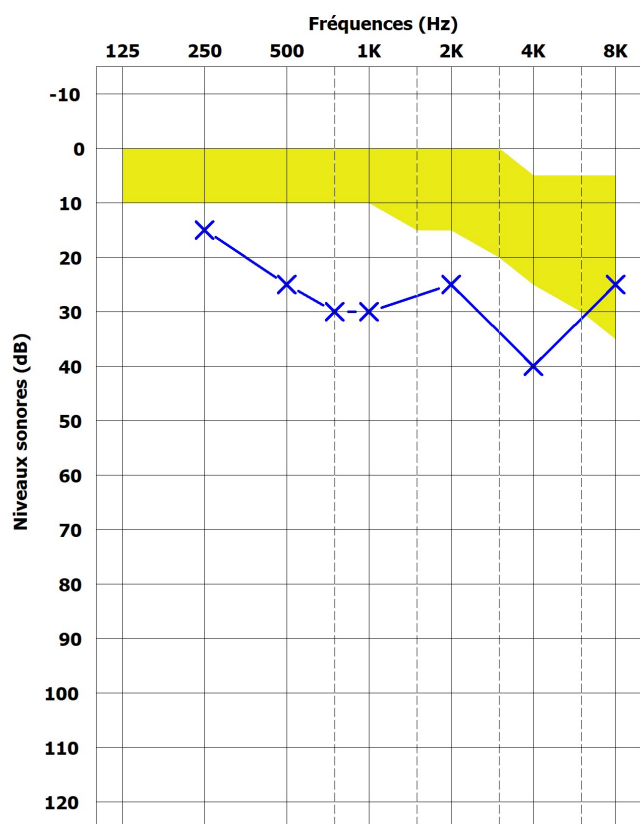

Oreille Gauche

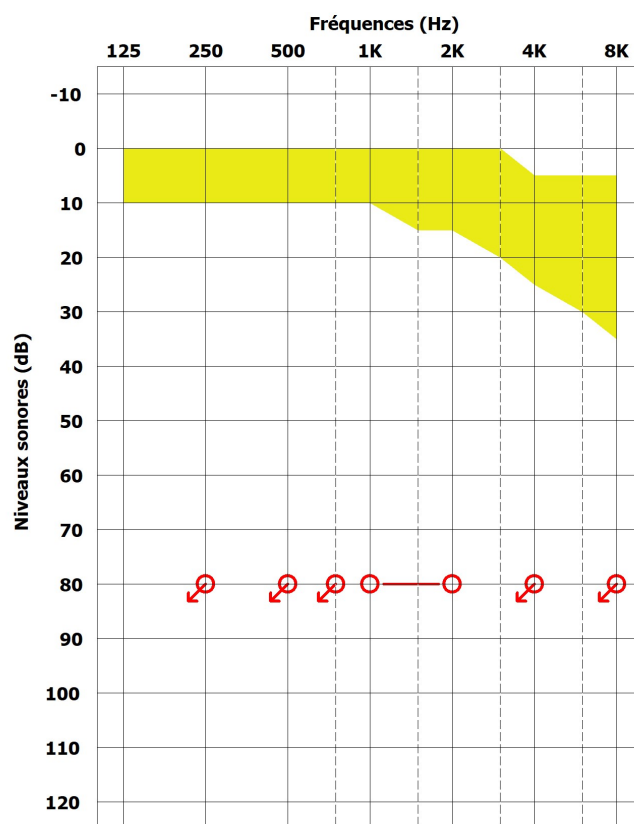

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	30	30		25		40		25
CA Droit		(80)	(80)	(80)	80		80		(80)		(80)

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	---	---

Notes