

MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 10:32:01

Durée: 11mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA YOUSOUF	
Date de naissance	03/06/1987
Age	36
Société	BCEIP
ID	24032910284181769

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

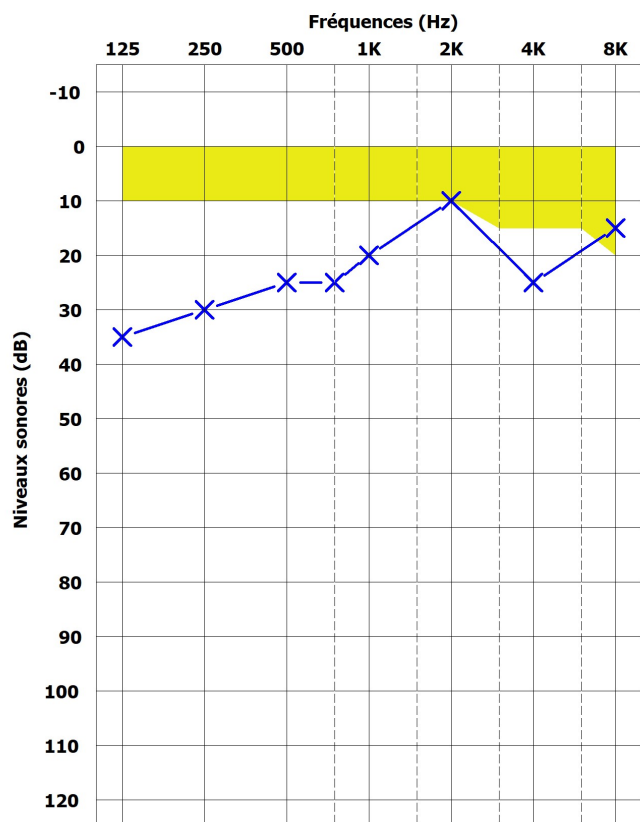

Oreille Gauche

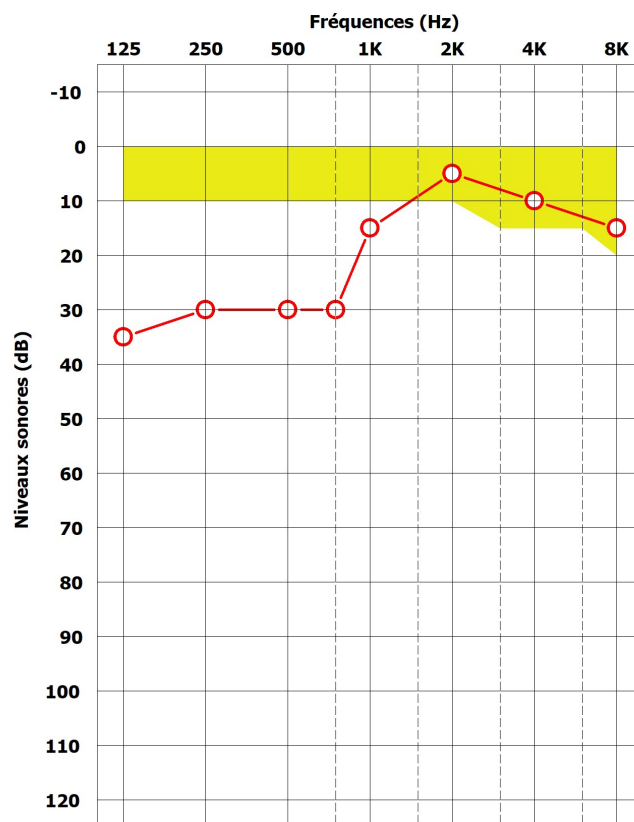

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	30	25	25	20		10		25		15
CA Droit	35	30	30	30	15		5		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes